



Hotplates & Stirrers

UC150 UC151 UC152 UC152D
US150 US151 US152 US152D

Instructions for use

Manuel d'utilisation

Istruzioni per l'uso

Instrucciones de funcionamiento

Bedienungsanweisung

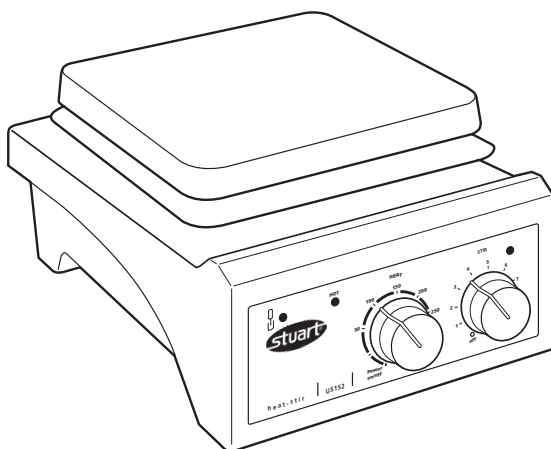


Figure 1 - Front view

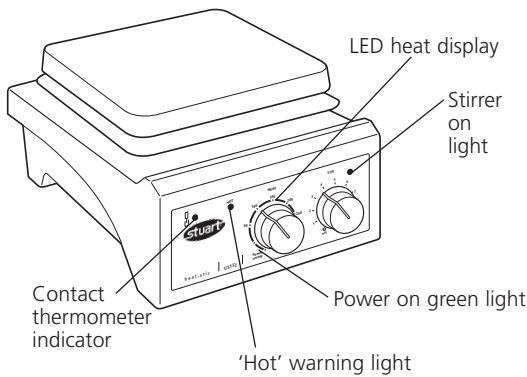


Figure 2 - Rear view

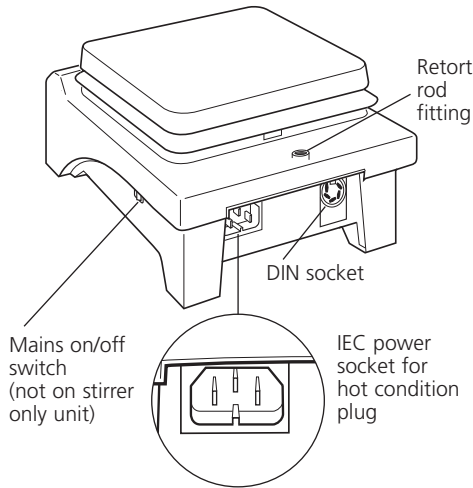


Figure 3 - Front panel (analogue versions)

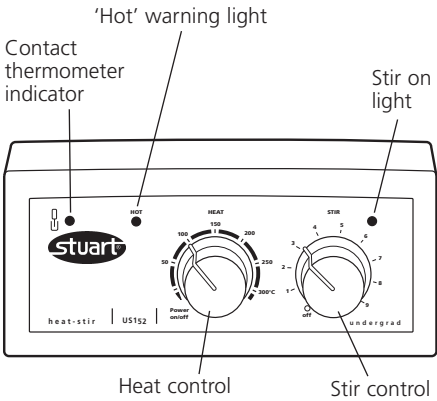


Figure 4 - Front panel (digital versions)

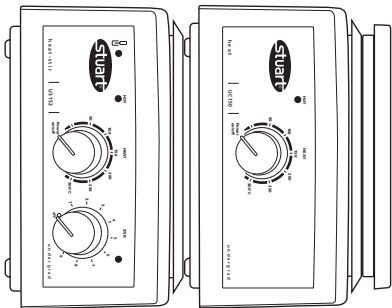
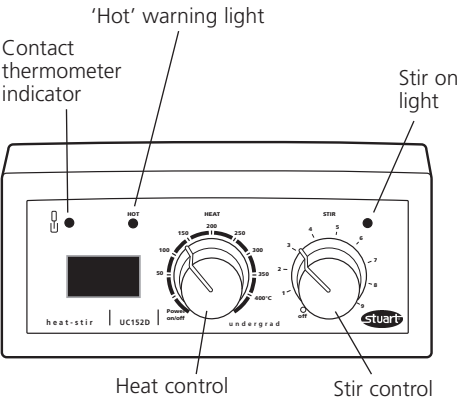


Figure 5 - Stacked on side view (as viewed from above)

Hotplates & Stirrers

UC150, UC151, UC152, UC152D
US150, US151, US152, US152D

Introduction

Thank you for purchasing this Bibby Scientific product. To get the best performance from the equipment, and for your own safety, please read these instructions carefully before use. Before discarding the packaging check that all parts are present and correct.

This equipment is designed to operate under the following conditions:

- ❖ For indoor use only
- ❖ Use in a well ventilated area
- ❖ Ambient temperature range +5°C to +40°C
- ❖ Altitude to 2000m
- ❖ Relative humidity not exceeding 80%
- ❖ Mains supply fluctuations not exceeding 10% of nominal
- ❖ Overvoltage category II IEC60364-4-443
- ❖ Pollution degree 2 IEC664
- ❖ Use with a minimum distance all round of 200mm from walls or other items

If the equipment is not used in the manner described in this manual and with accessories other than those recommended by Bibby Scientific, the protection provided may be impaired.

Electrical Installation



THIS EQUIPMENT MUST BE EARTHED

Before connection please ensure that the line supply corresponds to that shown on the rating plate located on the base of the unit.

Power requirements:

Model	Wattage	Model	Wattage
UC150	500W	US150	700W
UC151	50W	US151	50W
UC152	550W	US152	750W
UC152D	550W	US152D	750W

There is a hot condition IEC socket at the rear of

the instrument for connection to the mains supply (see figure 2). The unit is supplied with a mains lead fitted with either a UK 3-pin or "Shuko" 2-pin hot condition IEC plug for connection to the instrument.

Should the lead not be suitable for connecting to the mains power supply, replace the plug with a suitable alternative.

THIS OPERATION SHOULD ONLY BE UNDERTAKEN BY A QUALIFIED ELECTRICIAN.

NOTE: Refer to the equipment rating plate to ensure that the plug and fusing are suitable for the voltage and wattage stated.

The wires in the mains cable are coloured as follows:

BROWN - LIVE
BLUE - NEUTRAL
GREEN/YELLOW - EARTH

Should the mains lead need replacement, a cable of 1mm² of harmonised code H05RR-F or H05RN-F connected to an IEC hot condition plug should be used.

IF IN DOUBT CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

The appropriate mains lead should be connected BEFORE connection to the mains supply.

Safety Advice

- ❖ Do not use the instrument to heat inflammable liquids.
- ❖ Never lift or carry the instrument until it has been switched off and allowed to cool for at least 30 minutes. The hot warning light will give guidance.
- ❖ The unit should be carried using both hands with the fingers under the side edges.
- ❖ Never move or carry the unit with containers on the top plate or while still connected to the mains supply.
- ❖ There is a danger of liquid spillage if containers are over-filled and stirred at high speed. Always build stirrer speed slowly and never stir more rapidly than necessary.


- ❖ NEVER place a cold glass vessel onto a hotplate which is already hot.
- ❖ NEVER use a retort rod longer than 600mm.
- ❖ When a retort rod is installed with apparatus attached, or when swivelling support rods, take care that there is sufficient weight on the plate to prevent the whole unit tipping over.
- ❖ When using a retort stand, in order to provide the unit with adequate ventilation the base of the retort stand must NOT exceed 19.5 mm in height and 125 mm in width.

Operation

Heating

UC150, UC152, US150, US152

Switch the unit on using the mains on/off switch (see figure 2).



The control knob labelled “HEAT” on the front panel controls the heat output and hence the plate temperature. It is graduated with an approximate temperature scale. This scale refers to the temperature of the top plate and not to the temperature of the contents of the vessel being heated.

Turn the control knob clockwise to the required plate temperature. As the plate heats up the LED temperature segments around the dial will light up in turn and their light intensity increase until the set surface temperature is reached. Conversely if the unit is cooling, the LED temperature segments will go out as the plate approaches the set temperature.

UC152D, US152D

Switch the unit on using the mains on/off switch (see Figure 2). When the control knob labelled “HEAT” is pointing to the Power on/off position,

the LED display will show the word “OFF”. Turn the control knob to the required temperature which will be shown on the LED display. The temperature will increment in 5°C steps. A few seconds after setting the temperature, the display will revert to showing the actual temperature of the hotplate.

If the unit is switched off using the mains on/off switch while the control is in a set position, the next time the unit is switched on the LED display will show the word “On” followed briefly by the previously set temperature. The display will then revert to the actual top plate temperature and the unit will then begin to heat to the set temperature.

WARNING: When the surface becomes too hot to touch the red “HOT” warning light on the front panel will begin to flash (see figure 1). This will continue to flash while the plate temperature is above 50°C for a maximum of 30 minutes, even if the unit is disconnected from the electricity supply.

WARNING: The plate may still be hot beyond 30 minutes when large masses are left on the plate, even though the “HOT” warning light has gone out.

WARNING: The top surface of the instrument may be **HOT**, especially in free air when a surface temperature of 450°C can be achieved on the ceramic top models and 325°C on the metal top models. Do not leave heaters switched on when not in use.

Stirring

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

Switch the unit on using the mains on/off switch (see figure 2). The control knob labelled “STIR” on the front panel controls the stirrer speed. When switched on a green stir-on light illuminates, (see figure 1). The knob is graduated with an arbitrary 1-9 scale. Turning the knob to a higher number increases the stirrer speed.

Using the Optional Accessory SCT1 Temperature Controller

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

The SCT1 temperature controller allows accurate temperature control of aqueous and oil based

samples in the laboratory and can be used in two different modes, as a precise temperature controller from 20 to 200°C or as a digital thermometer from -4 to 325°C.

Connection of the SCT1 temperature controller probe is via the DIN probe socket located at the rear of the hotplate (figure 2).

In control mode, the heat control of the hotplate is disabled, allowing precise control of sample temperature via the SCT1 temperature controller. The illuminated contact thermometer indicator LED indicates communication between the SCT1 temperature controller and hotplate (Figure 3).

When used in monitor mode, the SCT1 operates as a digital thermometer and the hotplate temperature is controlled by the "HEAT" control knob as described above. In this mode the LED temperature segments adjacent to the "HEAT" control knob (analogue models) or the LED temperature display (digital models) refer to the surface temperature of the hotplate not the sample.

For full instructions on use please refer to the SCT1 temperature controller manual.

Cleaning and Care

Before attempting cleaning:

Ensure that the top is cool, disconnect from the mains electricity supply.

The metal casing should be cleaned using a damp cloth and a mild detergent solution.

Ceramic top units:

A damp cloth will normally remove most types of contamination. For more difficult stains a domestic cream cleanser is recommended.

Cleaning is made easier if spillages are attended to promptly. In any case, spillages of alkali, phosphoric acid and hydrofluoric acid MUST be removed immediately as these chemicals can attack and damage the glass ceramic. Ensure that the appropriate safety precautions are observed.

During cleaning and general operation take care not to scratch the surface of the top plate as this could result in subsequent thermal breakage.



WARNING: A ceramic top which is scratched, chipped, chemically etched or damaged must not be used.

Metal top units:

The metal top plate should be cleaned using a damp cloth and a mild detergent solution.

Cleaning is made easier if spillages are attended to promptly. In any case, spillages of acids and alkalis MUST be removed immediately as these chemicals can attack and damage the surface of the coated aluminium alloy. Ensure that the appropriate safety precautions are observed.

Preparation of media

Take particular care when heating liquids having a high viscosity. Viscous liquids can act as thermal insulators and can cause thermal breakage of the glassware. This is very important with media solutions as the viscosity will usually increase as the temperature rises.

- ❖ Check that the stirring action is sufficient to agitate the whole of the liquid. Unstirred areas in the liquid can result in uneven heat transfer and "hot spots" in the glassware. This can induce thermal stress and so cause failure.
- ❖ Check the stirring action regularly to ensure that it remains adequate as the viscosity of the solution increases.
- ❖ Always use the largest magnetic follower possible and if necessary, use a mechanical overhead stirrer.
- ❖ Do not use glass vessels with thick walls, e.g. Pyrex Heavy Duty Ware or standard beakers and flasks having capacities of 5 litres or greater.
- ❖ NEVER heat glass bottles on a hotplate.
- ❖ Ensure that the heat is built up slowly to avoid localised overheating.
- ❖ Ensure the glassware is completely free from scratches or other defects.
- ❖ Place the hotplate in a tray large enough to contain the liquid in the event of glassware failure.
- ❖ Wear the appropriate safety clothing e.g. gloves, goggles, protective apron etc.

Storage

The unit is designed so that the top plate fits into the base plate of the next unit for easy and compact storage when placed on their side (see figure 5).

Accessories

SR1

The SR1 rod is available to support apparatus used with the instrument. The instrument is equipped with a fitting on the rear to accept the support rod catalogue number SR1 (see figure 2). To fit the rod to your instrument, first isolate from the mains supply and allow to cool. Screw the threaded end of the support rod into the fitting on the rear of the instrument. The shape of the base also allows a rectangular shaped retort rod stand, whose dimensions must not exceed 19.5mm high and 125mm wide, to be placed directly underneath the unit. SR1 is 12 x 600mm (W x H).

SCT1

For more information on the SCT1 temperature controller see page 4.

Heating blocks

A complete range of modular heating blocks for heating round bottom flasks is available for use with the metal top hotplates. Please visit the Bibby Scientific website www.bibby-scientific.com for further information.

Troubleshooting

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

The following error codes are displayed if the instrument detects an error condition. On the digital models the errors are shown as Er1, Er2 etc. on the LED display. On the analogue models the Er1 condition is shown by flashing the first LED on the temperature scale, Er2 would be shown by flashing the second LED and so on.

- ❖ **Er1** – Probe Range Error – If SCT1 reports probe temperature of $>325^{\circ}\text{C}$ or $< -99^{\circ}\text{C}$.
- ❖ **Er2** – SCT1 Box Lost Error – Communications with the SCT1 have been lost.
- ❖ **Er3** – Hotplate Temperature Error – If the hotplate measures its temperature $> 585^{\circ}\text{C}$ or $< -9.9^{\circ}\text{C}$.
- ❖ **Er4** – Hotplate Ambient Error – If the temperature sensed inside the hotplate (not the plate temperature) is 85°C .

- ❖ **Er5** – SCT1 Character Error – An unknown character was received from the SCT1.
- ❖ **Er6** – Probe Out Error – The instrument detects that the SCT1 probe has been removed from the solution being heated.
- ❖ **Er7** – SCT1 Timeout Error – The SCT1 did not respond to a request in the required time.

Servicing and Repair

This product range does not require any routine servicing.

Note: There are no internal user replaceable parts.

In the event of product failure it is recommended that any repair is only undertaken by suitably qualified personnel. For advice or to receive a service manual please contact the Service Department of Bibby Scientific Ltd.

Only spare parts supplied by Bibby Scientific or its agent should be used. Fitting of non-approved parts may affect the performance of the safety features of the instrument.

Note: The magnetic stirrer drive utilises strong magnets.

If in doubt, please contact the Service Department:

Bibby Scientific Ltd.
Stone, Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 810475
Fax: +44 (0)1785 813748
e-mail service@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Spares

For a comprehensive parts list please contact the Service Department of Bibby Scientific Ltd quoting model and serial number.

For any other technical enquiries, please contact the Technical Support Department:

E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com,
Tel: +44 (0)1785 810433.

Warranty

Bibby Scientific warrants this equipment to be free from defects in material and workmanship, when used under normal laboratory conditions, for a period of **three (3)** years. In the event of a justified claim, Bibby Scientific will replace any defective component or replace the unit free of charge.

This warranty does NOT apply if:

- ❖ A ceramic top has broken due to mechanical impact, scratching, chipping or chemical etching.
- ❖ Any repair has been made or attempted other than by Bibby Scientific or its agent.
- ❖ Minor coating chips and scratches appear from what is deemed normal use.
- ❖ Damage is caused by fire, accident, misuse, neglect, incorrect adjustment or repair, damage caused by installation, adaptation, modification or fitting of non-approved parts.

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone,
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Technical Specification

Hotplate Stirrers	US152	UC152	US152D	UC152D
Plate material	Coated aluminium/silicon	Glass ceramic	Coated aluminium/silicon	Glass ceramic
Plate dimensions, mm	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Heated area, mm	150 x 150	120 x 120	150 x 150	120 x 120
Heater control	Analogue	Analogue	Digital	Digital
Heater power, W	700	500	700	500
Max. plate temp, °C	325	450	325	450
Min. set temp, °C	-	-	25	25
Stirrer speed, rpm	100-2000	100-2000	100-2000	100-2000
Max. stirring capacity, L*	15	15	15	15
Compatible with SCT1	Yes	Yes	Yes	Yes
Control accuracy with SCT1	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Dimensions (w x d x h), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Net weight, kg	2.9	2.9	2.9	2.9
Power, W	750	550	750	550
Electrical supply	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz
IP rating	32	32	32	32

Hotplates	US150	UC150
Plate material	Coated aluminium/silicon	Glass ceramic
Plate dimensions, mm	150 x 150	150 x 150
Heated area, mm	150 x 150	120 x 120
Heater control	Analogue	Analogue
Heater power, W	700	500
Max. plate temp, °C	325	450
Compatible with SCT1	Yes	Yes
Control accuracy with SCT1	±1°C	±1°C
Dimensions (w x d x h), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Net weight, kg	2.2	2.2
Power, W	700	500
Electrical supply	120V, 60Hz or 230V, 50Hz	120V, 60Hz or 230V, 50Hz
IP rating	32	32

Stirrers	US151	UC151
Plate material	Stainless steel	Glass ceramic
Plate dimensions, mm	150 x 150	150 x 150
Stirrer speed, rpm	100-2000	100-2000
Max. stirring capacity, L*	15	15
Compatible with SCT1	No	No
Dimensions (w x d x h), mm	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Net weight, kg	2.0	2.0
Power, W	50	50
Electrical supply	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz	120V, 60Hz or 230V, 50Hz or 220V, 60Hz
IP rating	32	32

**Based on water contained in a 20 litre glass bottom flask.*

Figure 1 - Vue de face

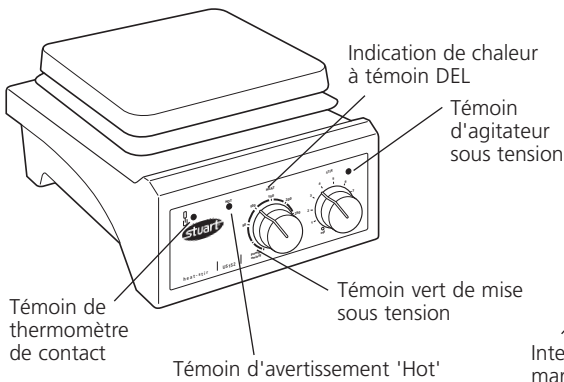


Figure 2 - Vue arrière

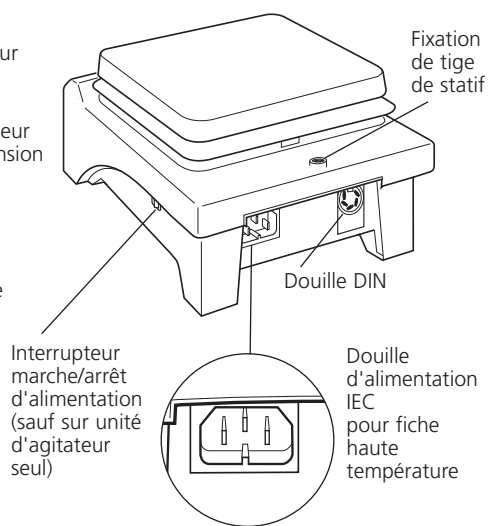


Figure 3 - Façade (versions analogiques)

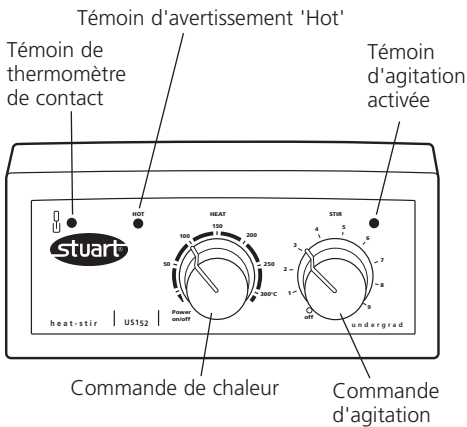


Figure 4 - Façade (versions numériques)

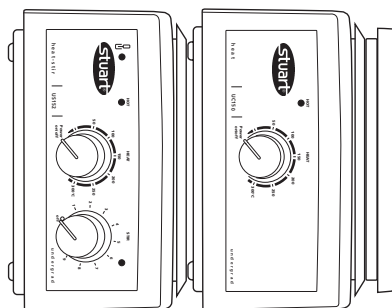
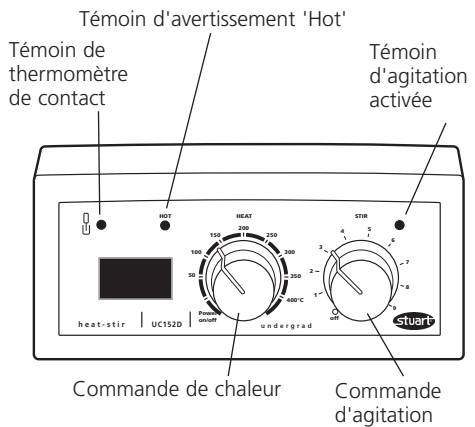


Figure 5 - Vue latérale d'unités empilées (vue du dessus)

Plaques chauffantes et agitateurs

UC150, UC151, UC152, UC152D,
US150, US151, US152, US152D

Introduction

Merci d'avoir fait l'acquisition de cet appareil Bibby Scientific. Pour profiter au mieux des performances de cet équipement, et pour votre sécurité, lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation. Avant de jeter l'emballage, vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.

Cet appareil est conçu pour fonctionner dans les conditions suivantes :

- ❖ Utilisation en intérieur uniquement
- ❖ Utilisation dans un lieu correctement ventilé
- ❖ Température ambiante de +5 °C à +40 °C
- ❖ Altitude maximale de 2000 m
- ❖ Taux d'humidité relative de 80 % maximum
- ❖ Fluctuations de l'alimentation secteur ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale
- ❖ Surtension de catégorie II CEI60364-4-443
- ❖ Degré de pollution 2 selon la norme CEI664
- ❖ Ménager un espace minimum de 200 mm autour de l'appareil par rapport aux murs et aux autres équipements.

En cas de non respect des consignes détaillées dans ce manuel ou en cas d'utilisation avec des accessoires différents de ceux recommandés par Bibby Scientific, la protection intégrée est susceptible de se révéler inopérante.

Installation électrique



CET APPAREIL DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.

Avant toute connexion, veuillez-vous assurer que l'alimentation secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique située sur la base de l'appareil.

Alimentation requise :

Modèle	Puissance en watts	Modèle	Puissance en watts
UC150	500 W	US150	700 W
UC151	50 W	US151	50 W
UC152	550 W	US152	750 W
UC152D	550 W	US152D	750 W

Un connecteur IEC haute température est fourni à l'arrière de l'appareil pour le raccordement à l'alimentation secteur (voir figure 2). L'appareil est fourni avec un cordon d'alimentation muni d'une fiche britannique à 3 broches ou d'une fiche IEC haute température « Shuko » à 2 broches pour le raccordement.

Si le cordon n'est pas adapté aux conditions particulières de votre pays, remplacez la fiche par un modèle approprié.

CETTE INTERVENTION DOIT UNIQUEMENT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

REMARQUE : reportez-vous à la plaque signalétique de l'appareil afin de vous assurer que la fiche et les fusibles sont adaptés à la tension et à la puissance mentionnées.

Les couleurs des fils du cordon d'alimentation sont les suivantes :
MARRON - PHASE
BLEU - NEUTRE
VERT/JAUNE - TERRE

Dans le cas où le cordon d'alimentation doit être remplacé, utilisez un câble d'1 mm² de type H05RR-F ou H05RN-F harmonisé, raccordé à une fiche IEC haute température.

EN CAS DE DOUTE, CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

Le cordon d'alimentation approprié doit être connecté à l'appareil **AVANT** de le connecter à une prise secteur.

Consignes de sécurité avant utilisation

- ❖ N'utilisez pas l'appareil pour chauffer des liquides inflammables.
- ❖ Ne soulevez et ne transportez jamais l'appareil avant de l'avoir mis hors tension et de l'avoir laissé refroidir pendant au moins 30 minutes. Vérifiez pour cela le voyant de température élevée (« HOT »).
- ❖ L'appareil doit être transporté à l'aide des deux mains, en plaçant les doigts sous les bords latéraux.
- ❖ Ne déplacez et ne transportez jamais l'appareil avec des récipients présents sur la plaque supérieure ou lorsqu'il est connecté à l'alimentation secteur.
- ❖ En cas de remplissage excessif et d'agitation à haute vitesse, il y a risque de débordement et de projection de liquide. Augmentez toujours progressivement la vitesse de l'agitateur et n'agitez jamais le liquide à une vitesse supérieure à ce qui est nécessaire.
- ❖ Ne placez JAMAIS un récipient en verre froid sur une plaque chauffante déjà chaude.
- ❖ N'utilisez JAMAIS de tige de statif de plus de 600 mm de long.
- ❖ Lorsqu'une tige de statif comportant un accessoire est installée ou en cas de rotation de la tige de support, assurez-vous que le poids présent sur la plaque est suffisant pour empêcher le basculement de l'ensemble de l'unité.
- ❖ Pour garantir la ventilation adéquate de l'unité lorsque vous utilisez un statif, la base de celui-ci ne doit PAS dépasser une hauteur de 19,5 mm et une largeur de 125 mm.


Utilisation

Chauffage

UC150, UC152, US150, US152

Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (voir figure 2).

Le bouton de réglage de température (« HEAT ») présent en façade permet de contrôler la chaleur produite et donc la température de la plaque. Il est gradué selon une échelle de température approximative. Cette échelle fait référence à la



température de la plaque supérieure et non à celle du contenu du récipient chauffé.

Faites tourner le bouton de réglage dans le sens horaire jusqu'à la température de plaque requise. Au fur et à mesure que la plaque se réchauffe, les segments LED de température entourant le bouton s'allument et leur intensité lumineuse augmente jusqu'à ce que la température de surface définie soit atteinte. Inversement, pendant le refroidissement de l'appareil, les segments LED s'éteignent au fur et à mesure que la plaque s'approche de la température définie.

UC152D, US152D

Mettez l'unité sous tension à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (voir figure 2). Lorsque le bouton réglage « HEAT » est placé sur la position marche/arrêt, l'écran LED affiche le mot « OFF ». Faites tourner le bouton de réglage jusqu'à la température requise (celle-ci s'affiche sur l'écran LED). La température augmente par incréments de 5 °C. Quelques secondes après le réglage de la température, l'écran affiche à nouveau la température réelle de la plaque chauffante.

Lorsque l'appareil est mis hors tension à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt alors que le bouton se trouve placé sur une température définie, lors de la mise sous tension suivante de l'appareil, l'écran LED affiche « ON », suivi brièvement de la dernière valeur de température définie. L'écran retourne ensuite à la température réelle de la plaque et l'appareil commence à chauffer jusqu'à atteindre la température définie.



AVERTISSEMENT : lorsque la surface

devient trop chaude au toucher, le voyant « HOT » de la façade commence à clignoter (figure 1). Il continue à clignoter tant que la température de la plaque est supérieure à 50 °C, pendant une durée maximale de 30 minutes, et

ce même si l'appareil est débranché de l'alimentation électrique.

 **AVERTISSEMENT :** la plaque peut rester chaude au-delà des 30 minutes dès lors que des masses importantes sont présentes, et ce même si le voyant « HOT » s'est éteint.

 **AVERTISSEMENT :** les parties supérieures de l'appareil peuvent être CHAUDES, en particulier à l'air libre du fait que la température de surface peut atteindre 450 °C avec les modèles à plaque en céramique et 325 °C sur les modèles à plaque métallique. Ne laissez pas l'appareil allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.

Agitation

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

Mettez l'unité sous tension à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (voir la figure 2). Le bouton de contrôle « STIR » en façade règle la vitesse de l'agitateur. Sous tension, un voyant vert d'agitation « Stir-on » s'allume (figure 1). Le bouton est gradué selon une échelle arbitraire de 1 à 9. La rotation du bouton vers un nombre plus élevé augmente la vitesse d'agitation.

Utilisation du contrôleur de température SCT1 optionnel

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Le contrôleur de température SCT1 est l'équipement idéal pour contrôler de manière précise la température des liquides aqueux et à base d'huile, en laboratoire. Il peut être utilisé de deux manières différentes : en tant que contrôleur de température de précision entre 20 et 200 °C ou en tant que thermomètre numérique entre -4 et 325 °C.

La sonde du contrôleur de température SCT1 se branche sur le connecteur DIN situé à l'arrière de la plaque chauffante (figure 2).

En mode contrôle, le contrôle de la température de la plaque chauffante est désactivé, ce qui permet une mesure précise de la température du liquide à l'aide du contrôleur SCT1. Lorsqu'il est allumé, le voyant du thermomètre à contact indique la bonne liaison entre le contrôleur de température SCT1 et la plaque chauffante (figure 3).

Lorsqu'il est utilisé en mode affichage, le SCT1 fonctionne en tant que thermomètre numérique et la température de la plaque chauffante est contrôlée par le biais du bouton de réglage « HEAT », comme décrit ci-dessus. Dans ce mode, les segments entourant le bouton de réglage « HEAT » (modèles analogiques) ou l'affichage LED des températures (modèles numériques) font référence à la température de surface de la plaque chauffante, et non à celle du liquide contenu dans le récipient.

Pour des instructions d'utilisation complètes, veuillez-vous reporter au manuel du contrôleur de température SCT1.

Nettoyage et entretien

Avant toute intervention de nettoyage :

Assurez-vous que la surface est froide et déconnectez l'appareil de l'alimentation secteur.

Le boîtier en métal doit être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

Modèles avec plaque en céramique :

Un chiffon humide suffit normalement à supprimer la plupart des types de contaminant. Pour les tâches plus difficiles, un nettoyant crème domestique est recommandé.

Le nettoyage des débordements est plus facile lorsqu'il est effectué dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, les déversements de liquides alcalins, d'acide phosphorique ou d'acide fluorhydrique DOIVENT être nettoyés immédiatement car ces produits chimiques peuvent attaquer et endommager les surfaces en vitrocéramique. Assurez-vous de respecter les précautions de sécurité appropriées.

Pendant les interventions de nettoyage et lors de l'utilisation en général, assurez-vous de ne pas rayer la surface de la plaque, car les rayures sont susceptibles d'entraîner une rupture thermique lors de l'utilisation suivante.

 **AVERTISSEMENT :** pour les modèles céramiques, en cas de rayures, d'écaillage ou de dommages dus à des produits chimiques, l'appareil ne doit pas être utilisé.

Appareil avec plaque en métal :

La plaque supérieure en métal doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux.

Le nettoyage des déversements est plus facile lorsqu'il est effectué dans les plus brefs délais. Dans tous les cas, les déversements de liquides alcalins et d'acides DOIVENT être nettoyés immédiatement car ces produits chimiques peuvent attaquer et endommager la surface à revêtement en alliage d'aluminium. Assurez-vous de respecter les précautions de sécurité appropriées.

Préparation des liquides

Une attention particulière doit être portée lors du chauffage de liquides à viscosité élevée. Ces liquides peuvent agir comme des isolants thermiques et occasionner une rupture de la verrerie sous l'effet de la chaleur. Ceci est très important pour les solutions, car la viscosité augmente généralement au fur et à mesure que la température s'élève.

- ❖ Assurez-vous que l'agitation est suffisante pour agiter la totalité du liquide. Les parties non agitées du liquide peuvent entraîner un transfert thermique hétérogène et des « points chauds » dans la verrerie. Ce phénomène peut entraîner une contrainte thermique, cause de rupture.
- ❖ Vérifiez régulièrement l'agitation afin de vous assurer qu'elle reste adaptée à l'augmentation de la viscosité de la solution.
- ❖ Utilisez toujours le plus grand barreau magnétique possible et, si nécessaire, un agitateur mécanique suspendu.
- ❖ N'utilisez pas de verrerie à parois épaisses, (verres en Pyrex haute résistance, etc.) ni de bécards ou de fioles standard d'une capacité de 5 litres ou plus.
- ❖ Ne chauffez JAMAIS de bouteilles en verre sur une plaque chauffante.
- ❖ Assurez-vous que le chauffage est progressif afin d'éviter toute surchauffe localisée.
- ❖ Assurez-vous que la verrerie est totalement exempte de rayures ou autres défauts.
- ❖ Placez la plaque chauffante dans un plateau suffisamment grand pour contenir le liquide en cas de casse de la verrerie.
- ❖ Portez des vêtements de sécurité appropriés, tels que des gants, des lunettes, un tablier protecteur, etc.

Rangement

L'appareil est conçu de manière à ce que la plaque supérieure tienne dans la plaque de base de l'appareil suivant, pour un rangement compact et pratique de plusieurs appareils placés sur le côté (figure 5).

Accessoires

SR1

La tige SR1 est disponible pour soutenir les instruments utilisés avec l'appareil. L'appareil comporte un logement en partie arrière destinée à recevoir la tige de support correspondant au code de catalogue SR1 (figure 2). Pour installer la tige sur votre appareil, commencez par couper l'alimentation secteur puis laissez-le refroidir. Vissez ensuite simplement l'extrémité filetée de la tige dans le logement situé en partie arrière. La forme de la base lui permet d'accueillir également un statif de forme rectangulaire, sous réserve que ses dimensions ne dépassent pas 19,5 mm de haut et 125 mm de large, à positionner directement sous l'appareil. Les dimensions de la tige SR1 sont 12 x 600 mm (l x H).

SCT1

Pour plus d'informations sur le contrôleur de température SCT1, voir page 12.

Blocs chauffants

Une gamme complète de blocs chauffants modulaires adaptés au chauffage des fioles à base arrondie est disponible pour une utilisation avec les plaques chauffantes métalliques. Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Web de Bibby Scientific : www.bibby-scientific.com

Dépannage

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Les codes d'erreur suivants s'affichent lorsque l'instrument détecte une condition d'erreur. Sur les modèles numériques, les erreurs s'affichent sur l'écran LED au format Er1, Er2, etc. Sur les modèles analogiques, l'erreur Er1 est indiquée par le clignotement du premier voyant LED de l'échelle de température, l'erreur Er2 est indiquée par le clignotement du deuxième voyant, et ainsi de suite.

- ❖ **Er1** – erreur de plage de sonde – lorsque le SCT1 indique une température de sonde > 325 °C ou < -99 °C.
- ❖ **Er2** – erreur de perte de boîtier SCT1 – perte de communication avec le SCT1.
- ❖ **Er3** – erreur de température de plaque chauffante – lorsque la température mesurée de la plaque chauffante est > 585 °C ou < -9,9 °C.
- ❖ **Er4** – erreur de température ambiante de plaque chauffante – lorsque la température mesurée à l'intérieur de la plaque chauffante (et non la température de la plaque) est de 85 °C.
- ❖ **Er5** – erreur de caractère SCT1 – lorsqu'un caractère inconnu est reçu du SCT1.
- ❖ **Er6** – erreur de retrait de sonde – lorsque l'instrument détecte que la sonde du SCT1 a été retirée de la solution chauffée.
- ❖ **Er7** – expiration du délai d'attente – lorsque le SCT1 ne répond pas dans les temps.

Entretien et réparation

Cette gamme d'appareils ne nécessite aucun entretien de routine.

Remarque : cet appareil ne renferme aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.

En cas de panne de l'appareil, il est recommandé de confier toute réparation à un personnel qualifié uniquement. Pour des conseils ou pour recevoir un manuel d'entretien, contactez le service d'assistance de Bibby Scientific Ltd

Seules des pièces détachées fournies par Bibby Scientific ou l'un de ses représentants doivent être utilisées. L'installation de pièces non approuvées est susceptible d'affecter l'efficacité des dispositifs de sécurité de l'appareil.

Remarque : l'entraînement de l'agitateur magnétique utilise des aimants puissants.

En cas de doute, veuillez contacter le service d'assistance :

Bibby Scientific Ltd. Stone, Staffordshire
ST15 0SA Royaume-Uni
Tél : +44 (0)1785 810475
Fax: +44 (0)1785 813748
Courriel : service@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Pièces de rechange

Pour obtenir la liste complète des pièces, veuillez contacter le service d'assistance de Bibby Scientific Ltd, en indiquant le modèle et le numéro de série.

Pour toute autre question technique, contactez le service d'assistance technique :
Courriel : stuarthelp@bibby-scientific.com,
Tél : +44 (0)1785 810433.

Garantie

Bibby Scientific garantit cet équipement contre tout défaut de pièces ou de main-d'œuvre, dans des conditions d'utilisation normale en laboratoire, pour une période de **trois (3) ans**. En cas de réclamation justifiée, Bibby Scientific remplacera gratuitement l'appareil ou tout composant défectueux.

Cette garantie ne s'applique PAS en cas de :

plaque supérieure en céramique cassée suite à un impact mécanique, une éraflure, un ébrèchement ou une attaque chimique ;

réparation effectuée ou tentée par une personne n'appartenant pas au personnel de Bibby Scientific ou de l'un de ses représentants,

revêtement légèrement ébréché ou éraflé du fait d'une usure jugée normale,

dommages provoqués par un incendie, un accident, une utilisation inappropriée, une négligence, un réglage incorrect, une réparation inadéquate, une installation, une adaptation ou une modification inappropriée ou l'installation de pièces non approuvées.

Bibby Scientific Limited
Bâtiment Le Deltaparc Parc Silic PN2
7 rue du Canal
BP 55437 VILLEPINTE
95944 ROISSY Charles de Gaulle
France
Tel: +33(0)148 63 78 03
Fax: +33(0)148 63 78 01
e-mail: ventes@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Caractéristiques techniques

Agitateurs de plaques chauffantes	US152	UC152	US152D	UC152D
Matériau de la plaque	Aluminium/silicium revêtu	Vitrocéramique	Aluminium/silicium revêtu	Vitrocéramique
Dimensions de la plaque, mm	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Surface chauffée, mm	150 x 150	120 x 120	150 x 150	120 x 120
Contrôle de l'élément chauffant	Analogique	Analogique	Numérique	Numérique
Puissance de chauffage, W	700	500	700	500
Temp. max. de la plaque, °C	325	450	325	450
Temp. min. de la plaque, °C	-	-	25	25
Vitesse de l'agitateur, tr/min	100-2000	100-2000	100-2000	100-2000
Capacité d'agitation max., L*	15	15	15	15
Compatible avec le SCT1	Oui	Oui	Oui	Oui
Précision de contrôle avec le SCT1	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Dimensions (l x p x h), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Poids net, kg	2.9	2.9	2.9	2.9
Puissance, W	750	550	750	550
Alimentation	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz
Indice de protection IP	32	32	32	32

Plaques chauffantes	US150	UC150
Matériau de la plaque	Aluminium/silicium revêtu	Vitrocéramique
Dimensions de la plaque, mm	150 x 150	150 x 150
Surface chauffée, mm	150 x 150	120 x 120
Contrôle de l'élément chauffant	Analogique	Analogique
Puissance de chauffage, W	700	500
Temp. max. de la plaque, °C	325	450
Compatible avec le SCT1	Oui	Oui
Précision de contrôle avec le SCT1	±1°C	±1°C
Dimensions (l x p x h), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Poids net, kg	2.2	2.2
Puissance, W	700	500
Alimentation	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz
Indice de protection IP	32	32

Agitateurs	US151	UC151
Matériau de la plaque	Acier inoxydable	Vitrocéramique
Dimensions de la plaque, mm	150 x 150	150 x 150
Vitesse de l'agitateur, tr/min	100-2 000	100-2 000
Capacité d'agitation max., L*	15	15
Compatible avec le SCT1	Non	Non
Dimensions (l x p x h), mm	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Poids net, kg	2	2
Puissance, W	50	50
Alimentation	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz ou 230 V, 50 Hz ou 220 V, 60 Hz
Indice de protection IP	32	32

* Basé sur de l'eau contenue dans une fiole à base en verre de 2 litre. Cet appareil est conforme aux normes

Figura 1 - Vista anteriore

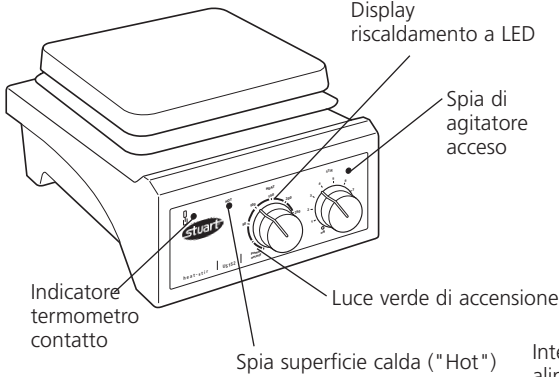


Figura 2 - Vista posteriore

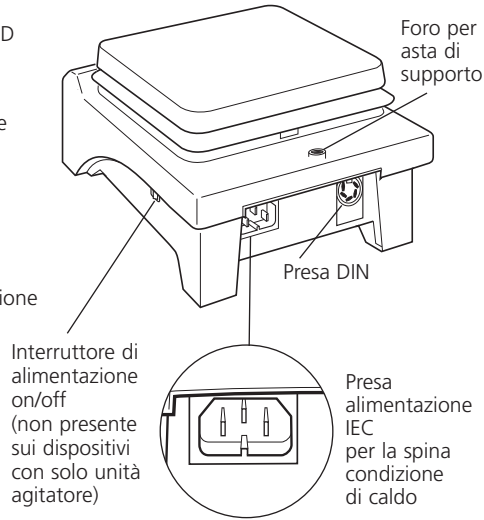


Figure 3 - Pannello frontale (versioni analogiche)

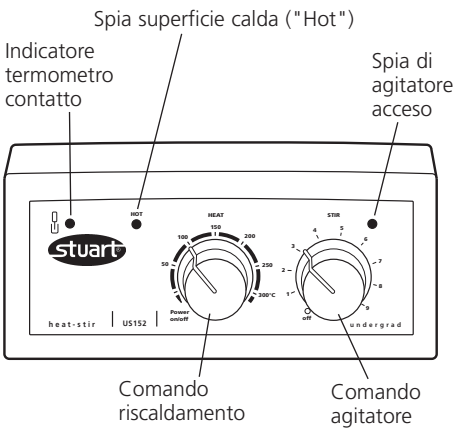


Figure 4 - Pannello frontale (versioni digitali)

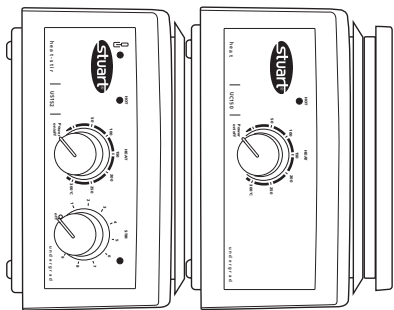
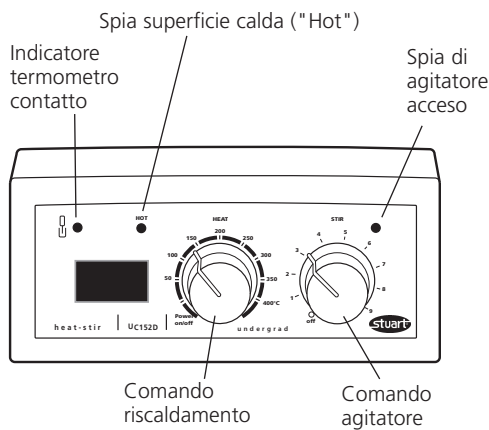


Figure 5 - Impilati su un fianco (vista dall'alto)

Piastre riscaldanti e agitatori

UC150, UC151, UC152, UC152D,
US150, US151, US152, US152D

Introduzione

Grazie per aver acquistato questo prodotto di Bibby Scientific. Per assicurare sempre prestazioni ottimali e per la propria sicurezza, leggere attentamente le istruzioni di questa apparecchiatura prima dell'uso. Prima di eliminare la confezione controllare che tutti i componenti siano presenti e integri.

Condizioni di esercizio previste:

- ❖ Solo per uso al chiuso
- ❖ Usare in ambienti ben ventilati
- ❖ Temperatura ambiente compresa tra +5 °C e +40 °C
- ❖ Altitudine fino a 2000 m
- ❖ Umidità relativa non superiore all'80%
- ❖ Oscillazione dell'alimentazione elettrica non superiore al 10% del valore nominale
- ❖ Categoria di sovratensione II IEC60364-4-443
- ❖ Grado di inquinamento 2 IEC664
- ❖ Utilizzare l'unità a una distanza minima di 200 mm dalle pareti e da altri oggetti.

L'uso per scopi diversi da quelli indicati sul manuale e l'impiego di accessori differenti da quelli raccomandati da Bibby Scientific possono compromettere la protezione fornita dall'apparecchio.

Installazione elettrica



IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE COLLEGATO A MASSA

Prima di effettuare il collegamento, assicurarsi che l'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta dei dati nominali situata alla base dell'unità.

Requisiti di alimentazione:

Modello	Potenza	Modello	Potenza
UC150	500W	US150	700W
UC151	50W	US151	50W
UC152	550W	US152	750W
UC152D	550W	US152D	750W

Sul retro dello strumento è presente una presa IEC per applicazioni calde da collegare all'alimentazione elettrica (vedere la Figura 2). Per collegare lo strumento, l'unità è dotata di un cavo di alimentazione con una spina a 3 pin (Regno Unito) o una spina a 2 pin IEC per applicazioni calde di tipo "Shuko".

Se il cavo non dovesse essere adatto per il collegamento all'alimentazione, sostituire la spina con un modello alternativo.

AFFIDARE QUESTA OPERAZIONE SOLO A UN ELETTRICISTA QUALIFICATO

NOTA: per assicurarsi che la spina e i fusibili siano adatti alla tensione e alla potenza indicate consultare la targhetta dei dati nominali dell'apparecchio.

Colori dei conduttori nel cavo di alimentazione:

MARRONE - FASE

BLU - NEUTRO

VERDE/GIALLO - TERRA

Se occorre sostituire il cavo di alimentazione, usare un cavo di 1 mm² di codice armonizzato H05RR-F o H05RN-F collegato a una spina IEC per applicazioni calde.

IN CASO DI DUBBI CONTATTARE UN ELETTRICISTA QUALIFICATO

Collegare il cavo di alimentazione PRIMA allo strumento, quindi alla presa di alimentazione.

Indicazioni di sicurezza da leggere prima dell'uso

- ❖ Non usare lo strumento per riscaldare liquidi infiammabili.
- ❖ Non sollevare o trasportare lo strumento quando è acceso, e attendere almeno 30 minuti dopo lo spegnimento affinché si raffreddi. Seguire l'indicazione della spia di avvertenza temperatura elevata.
- ❖ L'unità deve essere trasportata usando entrambe le mani con le dita sotto i bordi laterali.
- ❖ Non spostare o trasportare l'unità quando sulla piastra superiore ci sono dei contenitori o mentre è collegata all'alimentazione elettrica.


- ❖ Vi è il pericolo che il liquido fuoriesca se i contenitori sono troppo pieni e vengono agitati ad alta velocità. Aumentare sempre la velocità dell'agitatore gradualmente e non superare mai quella necessaria.
- ❖ Non posizionare MAI un recipiente di vetro freddo su una piastra riscaldante già calda.
- ❖ Non usare MAI un'asta di supporto più lunga di 600 mm.
- ❖ Quando un'asta di supporto viene installata con l'apparecchio fissato, o quando le aste di supporto girano, assicurarsi che vi sia un peso sufficiente sulla piastra per evitare che l'intera unità si ribalti.
- ❖ Quando si usa un supporto di laboratorio, al fine di fornire all'unità una ventilazione adeguata, la base di tale supporto NON deve superare i 19,5 mm di altezza e i 125 mm di larghezza.

Funzionamento

Riscaldamento

UC150, UC152, US150, US152

Accendere l'unità usando l'interruttore di alimentazione on/off (vedere la Figura 2).



La manopola di controllo "HEAT" (CALORE) sul pannello frontale controlla l'uscita di calore e quindi la temperatura della piastra. È graduata con una scala approssimativa della temperatura. Tale scala si riferisce alla temperatura della piastra superiore e non alla temperatura del contenuto dei recipienti che vengono riscaldati.

Ruotare la manopola in senso orario fino alla temperatura richiesta della piastra. Mentre la piastra si riscalda, i segmenti LED della temperatura intorno alla manopola si accendono

e la loro luminosità aumenta fino a quando la superficie non raggiunge la temperatura impostata. Al contrario, se l'unità si raffredda, i segmenti LED della temperatura si spengono man mano che la piastra si avvicina alla temperatura impostata.

UC152D, US152D

Accendere l'unità usando l'interruttore di alimentazione on/off (vedere la Figura 2). Quando la manopola "HEAT" è rivolta verso la posizione Power on/off (accensione spegnimento), il display LED mostra la parola "OFF". Ruotare la manopola sulla temperatura richiesta che verrà mostrata sul display LED. La temperatura aumenta in step di 5°C. Alcuni secondi dopo aver impostato la temperatura, il display passa a mostrare la temperatura effettiva della piastra riscaldante.

Se l'unità viene spenta usando l'interruttore di alimentazione on/off mentre il comando è in una posizione impostata, all'accensione successiva dell'unità, il display LED mostrerà la parola "On" seguita a breve dalla temperatura precedentemente impostata. Il display passerà quindi a mostrare la temperatura effettiva della piastra superiore e l'unità inizierà a riscaldarsi fino alla temperatura impostata.

ATTENZIONE: Quando la superficie diventa troppo calda per essere toccata, la spia di avvertenza temperatura elevata "HOT" inizia a lampeggiare sul pannello frontale (vedere la Figura 1). Quando la temperatura della piastra supera i 50 °C, la spia continua a lampeggiare per un massimo di 30 minuti, anche se l'unità viene scollegata dall'alimentazione elettrica.

ATTENZIONE: La piastra potrebbe essere calda per oltre 30 minuti quando vi si lasciano sopra oggetti di grandi dimensioni, anche se la spia "HOT" si è spenta.

ATTENZIONE: La superficie dello strumento stesso potrebbe essere CALDA, in particolare nell'aria ambiente quando la superficie raggiunge una temperatura di 450 °C sui modelli in ceramica, e di 325 °C sui modelli in metallo. Non lasciare le piastre riscaldanti accese quando non vengono utilizzate.

Agitazione

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

Accendere l'unità usando l'interruttore di alimentazione on/off (vedere la Figura 2). La manopola "STIR" (AGITATORE) sul pannello frontale controlla la velocità di agitazione. Quando si accende, si illumina una spia verde (vedere la Figura 1). La manopola è graduata su una scala arbitraria da 1 a 9. Ruotando la manopola verso un numero maggiore, si aumenta la velocità di agitazione.

Uso dell'accessorio opzionale controller della temperatura SCT1

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Il controller della temperatura SCT1 consente un controllo preciso della temperatura di campioni a base acquosa e oleosa in laboratorio, e può essere utilizzato in due modalità diverse: come controller di precisione della temperatura da 20 a 200 °C o come termometro digitale da -4 a 325 °C.

Il collegamento della sonda del controller della temperatura SCT1 viene effettuato attraverso la presa della sonda DIN situata sulla parte posteriore della piastra riscaldante (vedere la Figura 2).

In modalità di controllo, il controllo del calore della piastra è disabilitato, consentendo così un controllo preciso della temperatura del campione attraverso il controller della temperatura SCT1. L'indicatore a LED del termometro di contatto illuminato indica la presenza di comunicazione tra il controller della temperatura SCT1 e la piastra (Figura 3).

Quando utilizzato in modalità monitor, l'SCT1 funziona come un termometro digitale e la temperatura della piastra riscaldante viene controllata mediante la manopola "HEAT" come descritto in precedenza. In questa modalità, i segmenti LED della temperatura adiacenti alla manopola "HEAT" (modelli analogici) o il display della temperatura LED (modelli digitali) fanno riferimento alla temperatura della superficie della piastra e non a quella del campione.

Per le istruzioni complete sul suo utilizzo, fare riferimento al manuale del controller della temperatura SCT1.

Pulizia e cura

Prima di iniziare la pulizia:

Assicurarsi che la piastra superiore sia fredda e scollegare l'alimentazione elettrica.

La struttura di metallo deve essere pulita con un panno umido e una soluzione detergente delicata.

Unità con superficie in ceramica:

Normalmente un panno umido è in grado di eliminare la maggior parte dei tipi di contaminanti. Per le macchie più difficili, si consiglia di usare un detergente in crema di uso domestico.

Eliminare immediatamente le fuoriuscite di materiale per facilitare la pulizia. In ogni caso, le fuoriuscite di alcali, acido fluoridrico e fosforico DEVONO essere rimosse immediatamente in quanto queste sostanze chimiche possono attaccare e danneggiare la vetroceramica. Assicurarsi di osservare le precauzioni di sicurezza appropriate.

Durante la pulizia e il normale funzionamento assicurarsi di non graffiare la superficie della piastra superiore per evitare una successiva rottura termica.



ATTENZIONE: Non utilizzare superfici in ceramica che risultino graffiate, scheggiate, corrosive o danneggiate.

Unità con superficie in metallo:

La piastra superiore in metallo deve essere pulita con un panno umido e una soluzione detergente delicata.

Eliminare immediatamente le fuoriuscite di materiale per facilitare la pulizia. In ogni caso, le fuoriuscite di acidi e alcali DEVONO essere rimosse immediatamente in quanto queste sostanze chimiche possono attaccare e danneggiare la superficie della lega di alluminio di rivestimento. Assicurarsi di osservare le precauzioni di sicurezza appropriate.

Preparazione dei mezzi

Prestare particolare attenzione quando si scaldano liquidi ad alta viscosità. I liquidi viscosi possono fungere da isolatori termici e causare la rottura termica degli oggetti in vetro. Si tratta di un

aspetto molto importante per le soluzioni dei mezzi, in quanto la viscosità solitamente aumenta all'aumentare della temperatura.

- ❖ Assicurarsi che l'azione mescolatrice sia sufficiente ad agitare tutto il liquido. Eventuali zone di liquido non agitate possono generare un trasferimento non uniforme del calore e degli "hot spot" negli oggetti di vetro. Questi a loro volta possono provocare shock termico e guasti.
- ❖ Controllare regolarmente l'azione mescolatrice per assicurarsi che sia adeguata all'aumento di viscosità della soluzione.
- ❖ Usare sempre la barretta di agitazione magnetica più grande possibile e se necessario usare un agitatore meccanico ad asta.
- ❖ Non usare recipienti di vetro con pareti spesse, ad es., articoli Pyrex ad alta resistenza o becher e palloni standard aventi una capacità di 5 litri o superiore.
- ❖ Non scaldare MAI bottiglie di vetro su una piastra riscaldante.
- ❖ Assicurarsi che il calore aumenti in modo graduale per evitare un eventuale surriscaldamento localizzato.
- ❖ Assicurarsi che gli oggetti di vetro siano completamente privi di graffi o altri difetti.
- ❖ Posizionare la piastra riscaldante su un vassoio abbastanza grande da contenere il liquido qualora gli strumenti di vetro si rompano.
- ❖ Utilizzare abbigliamento e strumenti di protezione adeguati, quali guanti, occhiali, camice protettivo e così via.

Conservazione

L'unità è stata progettata in modo tale che la piastra superiore alloggi perfettamente nella piastra base dell'unità successiva per una conservazione semplice e compatta di più unità quando vengono disposte su un lato (vedere la Figura 5).

Accessori

SR1

L'asta SR1 è disponibile come apparecchio di supporto utilizzabile con il dispositivo. Lo strumento è dotato di un raccordo sulla parte posteriore per installare l'asta di supporto SR1 (vedere la Figura 2). Per inserire l'asta nello strumento, scollegare innanzitutto l'alimentazione elettrica e lasciare che si raffreddi. Quindi avvitare l'estremità filettata dell'asta di supporto nel raccordo presente sulla parte posteriore del dispositivo. La forma della base consente inoltre l'utilizzo di un sostegno per l'asta di supporto di forma rettangolare, le cui dimensioni non devono superare i 19,5 mm di altezza e i 125 mm di larghezza, da posizionare direttamente sotto l'unità. L'accessorio SR1 è 12 x 600 mm (L x A).

SCT1

Per maggiori informazioni sul controller della temperatura SCT1 fare riferimento a pagina 19.

Blocchi riscaldanti

Le piastre riscaldanti in metallo possono essere utilizzate con una serie completa di blocchi riscaldanti modulari per scaldare i palloni a fondo tondo. Per maggiori informazioni visitare il sito web di Bibby Scientific www.bibby-scientific.com.

Risoluzione dei problemi

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Se lo strumento rileva un errore, vengono visualizzati i seguenti codici di errore. Nei modelli digitali, gli errori sono mostrati come Er1, Er2 ecc. sul display LED. Nei modelli analogici, la condizione Er1 viene indicata attraverso il lampeggiamento del primo LED nella scala della temperatura, Er2 invece attraverso il lampeggiamento del secondo LED e così via.

- ❖ **Er1** – Errore range della sonda – Se SCT1 riporta che la temperatura della sonda è $> 325\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $< -99\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ❖ **Er2** – Errore perdita box SCT1 – Perdita della comunicazione con l'SCT1.
- ❖ **Er3** – Errore temperatura piastra – Se la piastra riscaldante misura una temperatura $> 585\text{ }^{\circ}\text{C}$ o $< -9,9^{\circ}\text{C}$.

- ❖ **Er4** – Errore ambiente piastra – Se la temperatura rilevata all'interno della piastra (non la temperatura della piastra) è di 85 °C.
- ❖ **Er5** – Errore carattere SCT1 – L'SCT1 ha ricevuto un carattere sconosciuto.
- ❖ **Er6** – Errore sonda fuori – Lo strumento rileva che la sonda dell'SCT1 è stata rimossa dalla soluzione che viene riscaldata.
- ❖ **Er7** – Errore timeout SCT1 – L'SCT1 non ha risposto a una richiesta entro il tempo richiesto.

Manutenzione e riparazione

Questa gamma di prodotti non necessita di manutenzione periodica.

Nota: Non sono presenti componenti interni sostituibili dall'utente.

In caso di guasto, qualsiasi riparazione deve essere effettuata solo da personale qualificato. Per ricevere indicazioni o per ottenere il manuale di assistenza, contattare il reparto di assistenza di Bibby Scientific Ltd.

Utilizzare solo ricambi forniti direttamente da Bibby Scientific o dai suoi rappresentanti. L'impiego di componenti non autorizzati può compromettere le prestazioni delle caratteristiche di sicurezza dello strumento.

Nota: La guida dell'agitatore magnetico utilizza delle calamite molto potenti.

In caso di dubbio, consultare il reparto di assistenza di Bibby Scientific Ltd.

Bibby Scientific Ltd.
Stone,
Staffordshire
ST15 0SA
Regno Unito
tel: +44 (0)1785 810475
fax: +44 (0)1785 813748
e-mail: service@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Ricambi

Per un elenco completo dei ricambi disponibili, contattare il reparto di assistenza di Bibby Scientific Ltd. indicando il modello e il numero di serie.

Per altre richieste di carattere tecnico contattare il Servizio di assistenza tecnica:

e-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com,
tel: +44 (0)1785 810433.

Garanzia

Bibby Scientific garantisce questo strumento da difetti di materiale e fabbricazione per un periodo di **tre (3)** anni, se utilizzato in normali condizioni di laboratorio. In caso di reclamo giustificato Bibby Scientific sostituirà gratuitamente qualsiasi componente difettoso o l'intera unità.

La garanzia sul prodotto NON è valida se:

- ❖ La superficie di ceramica si è rotta a causa di urti, graffi, scheggiature o corrosioni chimiche.
- ❖ È stata effettuata o tentata una riparazione da un soggetto diverso da Bibby Scientific o dal suo rappresentante.
- ❖ Compaiono lievi scheggiature e graffi del rivestimento durante il normale utilizzo.
- ❖ In presenza di danni dovuti a: incendi, incidenti, uso non conforme, negligenza, errori di regolazione o di riparazione, danni dovuti a installazioni, adattamenti, modifiche, montaggio di componenti non approvati.

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone,
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Specifiche tecniche

Piastre riscaldanti e agitatori	US152	UC152	US152D	UC152D
Materiale della piastra	Rivestimento di alluminio/silicio	Vetroceramica	Rivestimento di alluminio/silicio	Vetroceramica
Dimensione piastra, mm	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Area riscaldata, mm	150 x 150	120 x 120	150 x 150	120 x 120
Comando riscaldamento	Analogico	Analogico	Digitale	Digitale
Potenza riscaldamento, W	700	500	700	500
Temp. max piastra °C	325	450	325	450
Temp. min impostazione, °C	-	-	25	25
Velocità agitatore, rpm	100-2000	100-2000	100-2000	100-2000
Capacità max agitatore, L*	15	15	15	15
Compatibile con SCT1	Sì	Sì	Sì	Sì
Precisione controllo con SCT1	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Dimensioni (L x P x A), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Peso netto, kg	2,9	2,9	2,9	2,9
Potenza, W	750	550	750	550
Alimentazione elettrica	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz
Grado di protezione IP	32	32	32	32

Piastre riscaldanti	US150	UC150
Materiale della piastra	Rivestimento di alluminio/silicio	Vetroceramica
Dimensione piastra, mm	150 x 150	150 x 150
Area riscaldata, mm	150 x 150	120 x 120
Comando riscaldamento	Analogico	Analogico
Potenza riscaldamento, W	700	500
Temp. max piastra °C	325	450
Compatibile con SCT1	Sì	Sì
Precisione controllo con SCT1	±1 °C	±1 °C
Dimensioni (L x P x A), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Peso netto, kg	2,2	2,2
Potenza, W	700	500
Alimentazione elettrica	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz
Grado di protezione IP	32	32

Agitatori	US151	UC151
Materiale della piastra	Acciaio inox	Vetroceramica
Dimensione piastra, mm	150 x 150	150 x 150
Velocità agitatore, rpm	100-2000	100-2000
Capacità max agitatore, L*	15	15
Compatibile con SCT1	No	No
Dimensioni (L x P x A), mm	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Peso netto, kg	2,0	2,0
Potenza, W	50	50
Alimentazione elettrica	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220 V, 60 Hz
Grado di protezione IP	32	32

**In base all'acqua contenuta in un pallone a fondo tondo di vetro da 20 litri.*

Figura 1: Vista frontal

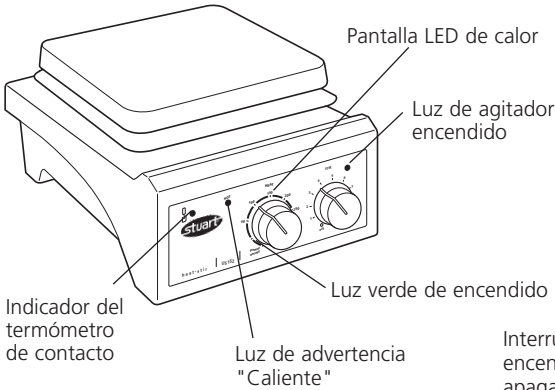


Figura 2: Vista posterior

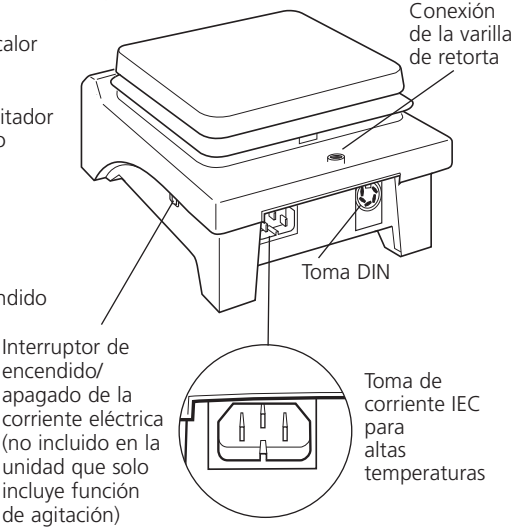


Figura 3:
Panel frontal (versiones analógicas)

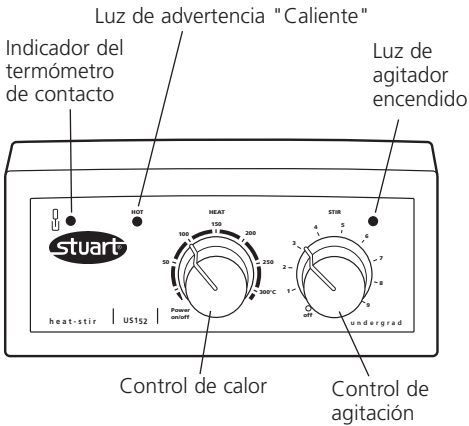


Figura 4:
Panel frontal (versiones digitales)

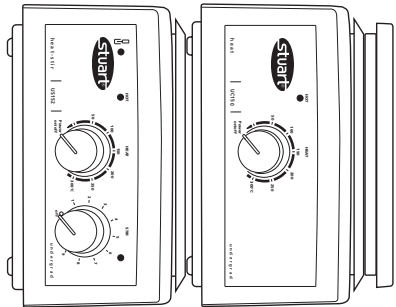
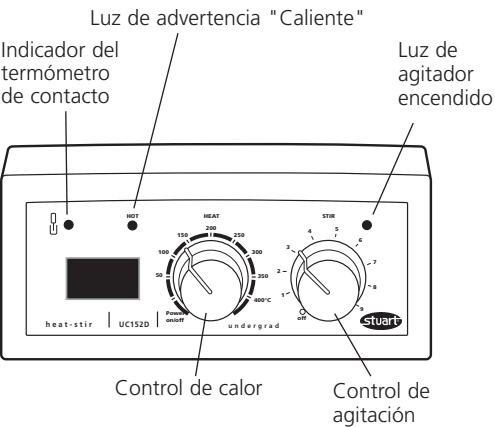


Figura 5: Apiladas en vista lateral (vistas desde arriba)

Placas calefactoras y agitadores

UC150, UC151, UC152, UC152D, US150, US151, US152, US152D

Introducción

Gracias por adquirir este producto de Bibby Scientific. Para conseguir el mejor rendimiento del equipo y por su propia seguridad, lea atentamente estas instrucciones antes de ponerlo en marcha. Compruebe que no falta ninguna pieza y que todas están en buen estado antes de desechar el embalaje.

Este equipo está diseñado para funcionar en las siguientes condiciones:

- ❖ Sólo para uso en interiores
- ❖ Debe utilizarse en un área bien ventilada
- ❖ Rango de temperatura ambiente de +5 °C a +40 °C
- ❖ Altitud hasta 2.000 m
- ❖ Humedad relativa no superior al 80 %
- ❖ Fluctuaciones del suministro eléctrico no superiores al 10 % del valor nominal
- ❖ Categoría de sobretensión II según la norma IEC60364-4-443
- ❖ Grado de contaminación 2 IEC664
- ❖ Usar a una distancia mínima de 200 mm de paredes u otros elementos

Si el equipo no se utiliza de la forma descrita en este manual y se emplean accesorios diferentes a los recomendados por Bibby Scientific, la protección ofrecida puede verse afectada.

Instalación eléctrica



ESTE EQUIPO DEBE CONECTARSE A TIERRA

Antes de conectarlo, asegúrese de que la alimentación de red corresponde a la indicada en la placa de especificaciones técnicas situada en la base de la unidad.

Potencia requerida:

Modelo	Potencia	Modelo	Potencia
UC150	500 W	US150	700 W
UC151	50 W	US151	50 W
UC152	550 W	US152	750 W
UC152D	550 W	US152D	750 W

En la parte posterior del aparato hay una toma de corriente IEC para altas temperaturas diseñada para conectar el equipo a la corriente eléctrica (ver figura 2). La unidad se suministra con un cable de alimentación equipado con un enchufe IEC para altas temperaturas de 3 clavijas para el Reino Unido, o tipo "Shuko" de 2 clavijas, para conectar el aparato.

Si el cable no es adecuado para su conexión a la red eléctrica, sustitúyalo por el enchufe correspondiente.

ESTA OPERACIÓN DEBE REALIZARLA UN ELECTRICISTA DEBIDAMENTE CAPACITADO

NOTA: Consulte la placa de características técnicas del equipo para asegurarse de que el enchufe y el fusible son adecuados para la tensión y potencia indicadas.

Los hilos del cable de alimentación tienen los colores siguientes:

MARRÓN - ACTIVO
AZUL - NEUTRO
VERDE/AMARILLO - TIERRA

Si es necesario sustituir el cable de alimentación, deberá utilizarse un cable de 1mm² de código armonizado H05RR-F o H05RN-F conectado a un enchufe IEC para altas temperaturas.

SI TIENE ALGUNA DUDA, CONSULTE A UN ELECTRICISTA ACREDITADO

ANTES de efectuar la conexión a la red eléctrica, deberá conectarse el cable de alimentación adecuado.

Aviso de seguridad antes del uso


- ❖ No usar el aparato para calentar líquidos inflamables.
- ❖ No levante ni transporte nunca el aparato sin apagarlo antes y déjelo enfriar al menos durante 30 minutos. La luz de advertencia de alta temperatura le servirá de indicador.
- ❖ La unidad debe transportarse con ambas manos, situando los dedos bajo los bordes laterales.
- ❖ No desplace ni transporte nunca la unidad si hay algún recipiente en la placa superior o si está conectada a la red eléctrica.
- ❖ Existe riesgo de que se viertan líquidos si los recipientes se llenan en exceso y se agitan a alta velocidad. Seleccione siempre una velocidad de agitación lenta, y nunca agite a mayor velocidad de la necesaria.
- ❖ No coloque NUNCA recipientes de vidrio fríos sobre una placa calefactora que esté caliente.
- ❖ No utilice NUNCA una varilla de soporte de longitud superior a 600 mm.
- ❖ Cuando instale una varilla de soporte fijada a un aparato, o al girar las varillas de soporte, cuide de que haya peso suficiente en la placa para evitar que caiga toda la unidad.
- ❖ Cuando use un soporte para pinzas, y para que la unidad disponga de una ventilación adecuada, la base del soporte para pinzas NO debe superar los 19,5 mm de altura ni los 125 mm de anchura.

Funcionamiento

Calefacción

UC150, UC152, US150, US152

Encienda la unidad usando el interruptor de encendido/apagado (ver figura 2).



El mando giratorio de control del "CALOR" presente en el panel frontal controla la emisión de calor y, por tanto, la temperatura de la placa. Está graduado con una escala de temperatura aproximada. Esta escala hace referencia a la temperatura en la superficie de la placa, y no a la temperatura del contenido del recipiente que se está calentando.

Gire el mando giratorio de control en sentido horario hasta la temperatura que desea que alcance la placa. A medida que la placa se calienta, los distintos segmentos LED de temperatura se iluminarán sucesivamente aumentando la intensidad de la luz hasta alcanzar la temperatura de superficie establecida. Por el contrario, si la unidad está refrigerando, los segmentos LED de temperatura se irán apagando a medida que la placa alcance la temperatura establecida.

UC152D, US152D

Encienda la unidad usando el interruptor de encendido/apagado (ver figura 2). Cuando el mando giratorio de control del "CALOR" señale la posición de encendido/apagado, la pantalla LED mostrará la palabra "APAGADO". Gire el mando de control giratorio hasta la temperatura deseada, que aparecerá en la pantalla LED. La temperatura se incrementará en pasos de 5 °C. Unos segundos después de ajustar la temperatura, la pantalla volverá a mostrar la temperatura real de la placa calefactora.

Si la unidad se apaga con el interruptor de encendido/apagado mientras que el control está en una posición fija, la próxima vez que la unidad se encienda, la pantalla LED mostrará la palabra "Encendido" seguida de la temperatura ajustada previamente. A continuación, la pantalla volverá a mostrar la temperatura real de la superficie de la placa y la unidad volverá a calentar hasta la temperatura programada.

⚠ ADVERTENCIA: Cuando la temperatura de la superficie es demasiado alta como para tocar el aparato, la luz roja de advertencia de "CALIENTE" del panel frontal empezará a parpadear (ver figura 1). Esta luz seguirá parpadeando mientras la temperatura de la placa sea superior a 50 °C durante un máximo de 30

minutos, incluso si la unidad se desconecta de la red de suministro eléctrico.

 **ADVERTENCIA:** La placa puede seguir caliente más de 30 minutos si se dejan en la placa objetos de gran tamaño, incluso si la luz de advertencia "CALIENTE" se ha apagado.

 **ADVERTENCIA:** La superficie superior del aparato puede estar CALIENTE, especialmente al aire libre, cuando pueden alcanzarse temperaturas de superficie de 450 °C en los modelos con superficie cerámica y 325 °C en los modelos con superficie metálica. No deje los calentadores encendidos cuando no se utilicen.

Agitación

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

Encienda la unidad usando el interruptor de encendido/apagado (ver figura 2). El mando de control giratorio "AGITAR" del panel frontal controla la velocidad del agitador. Cuando el agitador está encendido, se ilumina una luz verde indicando que el agitador está activado (ver figura 1). El mando giratorio incluye una escala graduada de forma arbitraria de 1 a 9. Al girar el mando de control giratorio a un valor numérico más alto, aumenta la velocidad del agitador.

Uso del controlador de temperatura SCT1 accesorio opcional

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

El controlador de temperatura SCT1 permite el control preciso de la temperatura de muestras con base acuosa u oleosa en el laboratorio, y puede usarse en dos modos diferentes: como controlador de precisión de la temperatura, de 20 a 200 °C, o como termómetro digital, de -4 a 325 °C.

La conexión de la sonda del controlador de temperatura SCT1 se realiza a través de la toma DIN para la sonda situada en la parte posterior de la placa calefactora (ver figura 2).

En modo control, el control del calor de la placa calefactora está desactivado, lo que permite un control preciso de la temperatura de la muestra a través del controlador de temperatura SCT1. El

LED indicador del termómetro de contacto iluminado indica la comunicación entre el controlador de temperatura SCT1 y la placa calefactora (figura 3).

Cuando se usa en modo monitor, el SCT1 funciona como un termómetro digital y la temperatura de la placa calefactora se controla con el mando de control de "CALOR", como se describió anteriormente. En este modo, los segmentos LED de temperatura que rodean al mando de control de "CALOR" (modelos analógicos) o la pantalla LED de temperatura (modelos digitales) indican la temperatura de la superficie de la placa calefactora y no la de la muestra.

Si desea conocer las instrucciones de uso completas, consulte el manual del controlador de temperatura SCT1.

Limpieza y cuidados

Antes de intentar limpiar el aparato:

Compruebe que la superficie de la placa está fría y desconecte la corriente eléctrica.

La carcasa metálica debe limpiarse con un paño húmedo y una solución detergente suave.

Unidades con placa superior de cerámica:

Un paño húmedo eliminará normalmente casi cualquier clase de contaminación. Para retirar manchas más rebeldes se recomienda el uso de una crema limpiadora casera.

La limpieza se facilita si los vertidos se retiran con rapidez. En cualquier caso, los vertidos de bases, ácido fosfórico y ácido fluorhídrico DEBEN retirarse de inmediato debido a que estos productos químicos pueden atacar y dañar la vitrocerámica. Asegúrese de que se adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Durante la limpieza y el uso general hay que tener cuidado de no rayar la superficie de la placa ya que esto podría originar un choque térmico posterior.

 **ADVERTENCIA:** Si la placa de cerámica está arañada, astillada, corroída por productos químicos o ha sufrido algún daño, no deberá usarse.

Unidades con placa superior metálica:

La placa superior metálica debe limpiarse con un paño humedecido y una solución detergente suave.

La limpieza se facilita si los vertidos se retiran con rapidez. En cualquier caso, los vertidos de ácidos y bases DEBEN eliminarse de forma inmediata, ya que estos productos químicos pueden atacar y dañar la superficie de la aleación de aluminio revestido. Asegúrese de que se adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Preparación de los medios

Tenga especial cuidado al calentar líquidos altamente viscosos. Los líquidos viscosos pueden actuar como aislantes térmicos y pueden provocar el choque térmico de materiales de vidrio. Esto es muy importante con los medios de cultivo, ya que normalmente la viscosidad aumentará a medida que aumenta la temperatura.

- ❖ Asegúrese de que la agitación sea lo suficientemente potente como para agitar todo el volumen de líquido. Las zonas de líquido que no se agiten pueden provocar transferencias de calor irregulares, produciendo "puntos calientes" en el material de vidrio. Esto podría provocar estrés térmico, provocando en consecuencia fallos.
- ❖ Compruebe regularmente la agitación para asegurarse de que es la correcta a medida que aumenta la viscosidad de la solución.
- ❖ Utilice siempre el agitador magnético del mayor tamaño posible y, si es necesario, utilice un agitador mecánico vertical.
- ❖ No utilice recipientes de vidrio de paredes gruesas, como los recipientes Heavy Duty Ware de Pyrex ni vasos o frascos de 5 litros o mayor capacidad.
- ❖ NUNCA caliente botellas de vidrio sobre una placa calefactora.
- ❖ Asegúrese de que el calor aumenta lentamente, para evitar un sobrecalentamiento localizado.
- ❖ Asegúrese de que el material de vidrio no presenta arañazos ni ningún otro defecto.

- ❖ Coloque la placa calefactora en una bandeja lo bastante grande para contener el líquido en caso de fallo del material de vidrio.
- ❖ Utilice ropa de seguridad adecuada, p. ej., guantes, gafas de seguridad, delantal protector, etc.

Almacenamiento

La unidad está diseñada para que la parte superior de la placa encaje en la base de la siguiente unidad, con el fin de almacenar de forma fácil y en un espacio reducido múltiples unidades colocadas en posición lateral (ver figura 5).

Accesorios

SR1

La varilla SR1 se encuentra disponible como soporte de los aparatos utilizados con el equipo. El equipo dispone de una conexión en la parte posterior para fijar la varilla de soporte, de referencia SR1 (ver figura 2). Para fijar la varilla al equipo, desconecte en primer lugar la corriente eléctrica y deje que se enfríe. Enrosque el extremo roscado de la varilla de soporte en el orificio situado en la parte posterior del equipo. La forma de la base también permite colocar un soporte de varilla de retorta rectangular, cuyas dimensiones no sean superiores a 19,5 mm de alto y 125 mm de ancho, para colocarla directamente debajo de la unidad. La dimensiones del modelo SR1 son 12 x 600 mm (ancho x alto).

SCT1

Para obtener más información sobre el controlador de temperatura SCT1, consulte la página 26.

Bloques calefactores

Una gama completa de bloques calefactores modulares para el calentamiento de matraces de fondo redondo se encuentra disponible para ser usados con placas calefactoras de superficie metálica. Para obtener más información, visite el sitio web de Bibby Scientific www.bibby-scientific.com.

Resolución de problemas

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Si el instrumento detecta una situación de error, se mostrarán los siguientes códigos de error. En los modelos digitales los errores se muestran en la pantalla LED como Er1, Er2, etc. En los modelos analógicos la situación Er1 se muestra mediante el parpadeo del primer LED de la escala de temperatura, Er2 se muestra mediante el parpadeo del segundo LED, y así sucesivamente.

- ❖ **Er1** – Error de rango en la sonda – Si SCT1 informa de una temperatura en la sonda > 325 °C o < -99 °C.
- ❖ **Er2** – Error pérdida de cuadro SCT1 – Se ha perdido la comunicación con el SCT1.
- ❖ **Er3** – Error temperatura de placa calefactora – Si la placa calefactora mide una temperatura > 585 °C o < -9,9 °C.
- ❖ **Er4** – Error de ambiente en placa calefactora – Si la temperatura medida en el interior de la placa calefactora (no la temperatura en la superficie de la placa) es 85 °C.
- ❖ **Er5** – Error de carácter en SCT1 – Se ha recibido un carácter desconocido desde SCT1.
- ❖ **Er6** – Error de sonda fuera – El aparato detecta que la sonda del SCT1 ha sido retirada de la solución que se está calentando.
- ❖ **Er7** – Error de tiempo de espera superado en SCT1 – El SCT1 no respondió a una solicitud en el tiempo requerido.

exclusivamente por personal debidamente capacitado. Si desea recibir asesoramiento o recibir un manual de servicio, póngase en contacto con el Departamento de Mantenimiento de Bibby Scientific Ltd.

Sólo deben utilizarse recambios originales suministrados por Bibby Scientific o sus agentes autorizados. La instalación de piezas no aprobadas puede afectar al rendimiento y a las características de seguridad del equipo.

Nota: El motor del agitador magnético utiliza imanes muy potentes.

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el Departamento de Mantenimiento:

Bibby Scientific Ltd.
Stone,
Staffordshire
ST15 0SA
Reino Unido
Tel.: +44 (0)1785 810475
Fax: +44 (0)1785 813748
E-mail: service@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Piezas de repuesto

Si desea obtener una lista completa de las piezas, póngase en contacto con el Departamento de Mantenimiento de Bibby Scientific Ltd, mencionando el modelo y el número de serie.

Para cualquier otra consulta técnica, póngase en contacto con el Departamento de Soporte Técnico:
E-mail: stuarthelp@bibby-scientific.com,
Tel.: +44 (0)1785 810433.

Mantenimiento y reparación

Los productos de esta gama no requieren revisiones de rutina.

Nota: No hay piezas internas que puedan ser sustituidas por el usuario.

En caso de fallo del producto se recomienda que las reparaciones sean llevadas a cabo

Garantía

Bibby Scientific garantiza que este equipo se encuentra libre de defectos de material o fabricación, siempre que se utilice en condiciones normales de laboratorio, durante un período de **tres (3) años**. En caso de una reclamación justificada, Bibby Scientific sustituirá los componentes defectuosos o toda la unidad sin cargo alguno.

Esta garantía NO será de aplicación en los siguientes casos:

- ❖ 1. La superficie cerámica se ha roto debido a un impacto mecánico, rasguño, desgaste o a corrosión por algún producto químico.
- ❖ 2. El aparato ha sido reparado o manipulado por personal no aprobado por Bibby Scientific o sus agentes.
- ❖ 3. Se observan pequeñas lascas y arañazos en el revestimiento a raíz de lo que se considera un uso normal.
- ❖ El daño ha sido causado por incendio, accidente, mal uso, negligencia, ajuste o reparación incorrectos, o se han producido daños por la instalación, adaptación, modificación o montaje de piezas no aprobadas.

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone,
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Especificaciones técnicas

Agitadores de placa calefactora	US152	UC152	US152D	UC152D
Material de la placa	Aluminio/silicio revestido	Vitrocerámica	Aluminio/silicio revestido	Vitrocerámica
Dimensiones de la placa, mm	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Área caliente, mm	150 x 150	120 x 120	150 x 150	120 x 120
Control del calentador	Analógico	Analógico	Digital	Digital
Potencia del calentador, W	700	500	700	500
Máx. temp. placa, °C	325	450	325	450
Mín. temp. establ., °C	-	-	25	25
Velocidad agitador, rpm	100-2.000	100-2.000	100-2.000	100-2.000
Máx. capacidad de agitación, l*	15	15	15	15
Compatible con SCT1	Sí	Sí	Sí	Sí
Precisión del control con SCT1	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Dimensiones (anch. x fon. x alt.), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Peso neto, kg	2,9	2,9	2,9	2,9
Potencia, W	750	550	750	550
Alimentación eléctrica	120 V, 60 Hz o 230V, 50Hz o 220V, 60Hz	120 V, 60 Hz o 230V, 50Hz o 220V, 60Hz	120 V, 60 Hz o 230V, 50Hz o 220V, 60Hz	120 V, 60 Hz o 230V, 50Hz o 220V, 60Hz
Grado IP	32	32	32	32

Placas calefactoras	US150	UC150
Material de la placa	Aluminio/silicio revestido	Vitrocerámica
Dimensiones de la placa, mm	150 x 150	150 x 150
Área caliente, mm	150 x 150	120 x 120
Control del calentador	Analógico	Analógico
Potencia del calentador, W	700	500
Máx. temp. placa, °C	325	450
Compatible con SCT1	Sí	Sí
Precisión del control con SCT1	±1 °C	±1 °C
Dimensiones (anch. x fon. x alt.), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Peso neto, kg	2,2	2,2
Potencia, W	700	500
Alimentación eléctrica	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz
Grado IP	32	32

Agitadores	US151	UC151
Material de la placa	Acero inoxidable	Vitrocerámica
Dimensiones de la placa, mm	150 x 150	150 x 150
Velocidad agitador, rpm	100-2.000	100-2.000
Máx. capacidad de agitación, l*	15	15
Compatible con SCT1	No	No
Dimensiones (anch. x fon. x alt.), mm	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Peso neto, kg	2,0	2,0
Potencia, W	50	50
Alimentación eléctrica	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220V, 60Hz	120 V, 60 Hz o 230 V, 50 Hz o 220V, 60Hz
Grado IP	32	32

*Basado en el agua contenida en un matraz de vidrio de 20 litros.

Abbildung 1 - Vorderansicht

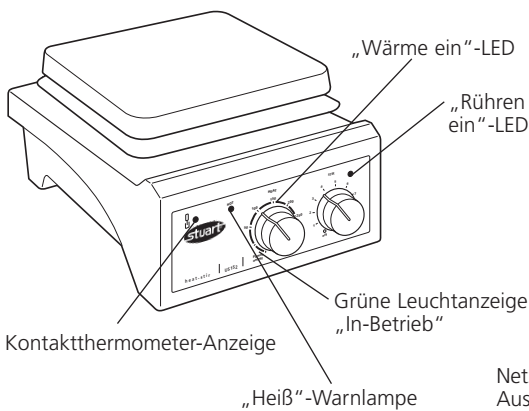


Abbildung 2 - Rückansicht

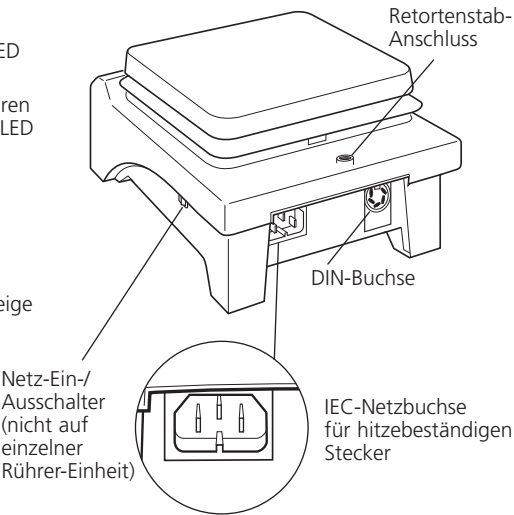


Abbildung 3: Vorderseite (analoge Versionen)

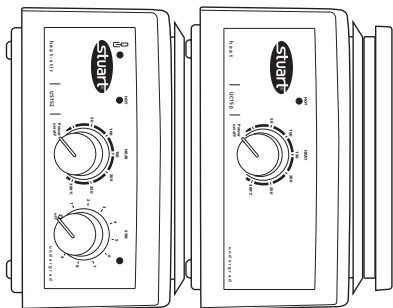
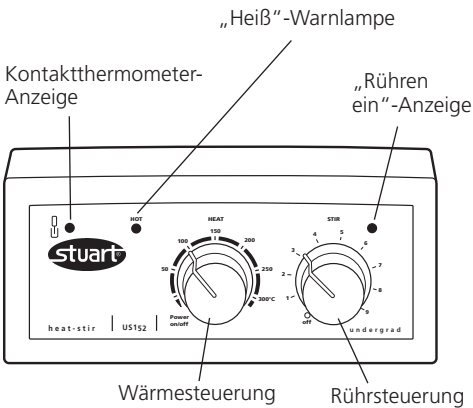


Abbildung 4: Vorderseite (digitale Versionen)

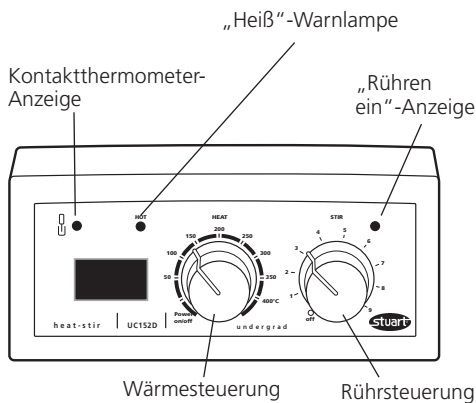


Abbildung 5: Auf der Seite liegend gestapelt (Draufsicht)

Heizplatten & Magnetrührer

UC150, UC151, UC152, UC152D,
US150, US151, US152, US152D

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Bibby Scientific-Produkt entschieden haben. Um die optimale Leistung des Geräts und Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten, lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Überprüfen Sie vor dem Entsorgen der Verpackung, ob alle Teile vorhanden und in Ordnung sind.

Dieses Gerät ist für den Betrieb unter folgenden Bedingungen ausgelegt:

- ❖ Nur für den Betrieb in Innenräumen
- ❖ Betrieb in gut belüfteten Räumen
- ❖ Umgebungstemperatur +5°C bis +40°C
- ❖ Höhenlage bis 2000 m
- ❖ Relative Luftfeuchtigkeit maximal 80 %
- ❖ Schwankungen in der Stromversorgung maximal 10 % des Sollwerts
- ❖ Überspannungskategorie II IEC60364-4-443
- ❖ Verschmutzungsgrad 2 IEC664
- ❖ Halten Sie einen Mindestabstand von 200 mm zu Wänden und anderen Dingen um das gesamte Gerät herum ein

Das Gerät darf nur in der hier beschriebenen Weise und mit Zubehör betrieben werden, das von Bibby Scientific empfohlen wurde, da andernfalls die eingebauten Schutzeinrichtungen beeinträchtigt werden können.

Elektrische Installation



DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Überprüfen Sie vor dem Anschließen, ob die Stromversorgung den Angaben auf dem Leistungsschild an der Unterseite des Geräts entspricht.

Strombedarf:

Modell	Wattleistung	Modell	Wattleistung
UC150	500W	US150	700W
UC151	50W	US151	50W
UC152	550W	US152	750W
UC152D	550W	US152D	750W

Hinten am Gerät befindet sich eine IEC-Warmgerätesteckdose zum Anschluss an die Netzstromversorgung (siehe Abbildung 2). Zum Netzanschluss des Geräts ist sein Netzkabel entweder mit einem 3-poligem Stecker (Vereinigtes Königreich) oder einem 2-poligem „Schuko“-IEC-Warmgerätestecker ausgestattet.

Sollte das Kabel sich nicht an der Netzstromversorgung anschließen lassen, ersetzen Sie den Stecker durch eine geeignete Alternative.

DIES MUSS VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER DURCHFÜHRT WERDEN

HINWEIS: Beachten Sie das Leistungsschild am Gerät, um sicherzustellen, dass der Stecker und die Sicherung auf die angegebene Spannung und Wattleistung ausgelegt sind.

Die Leiter des Netzkabels sind wie folgt farbcodiert:

BRAUN - SPANNUNGSFÜHREND
BLAU - NEUTRAL
GRÜN/GELB - ERDUNG

Sollte das Netzkabel ausgewechselt werden müssen, muss ein 1 mm² Kabel der harmonisierten Codes H05RR-F oder H05RN-F in Verbindung mit einem IEC-Warmgerätestecker verwendet werden.

IM ZWEIFEL EINEN QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ZU RATE ZIEHEN

Ein geeignetes Netzkabel muss angeschlossen werden **BEVOR** das Gerät mit der Netzstromversorgung verbunden wird.

Sicherheitshinweise vor Gebrauch


- ❖ Gerät nicht zum Erwärmen entzündbarer Flüssigkeiten verwenden.
- ❖ Gerät erst anheben oder tragen, nachdem es ausgeschaltet wurde und mindestens 30 Minuten abgekühlt ist. Richten Sie sich nach der Warnleuchte "Hot" (Heiß).
- ❖ Das Gerät muss mit beiden Händen getragen werden, wobei mit den Fingern unter die Seitenränder gegriffen wird.
- ❖ Gerät nie bewegen oder tragen, wenn Gefäße auf der Platte stehen oder wenn es noch am Netzstrom angeschlossen ist.
- ❖ Es besteht die Gefahr, dass Flüssigkeit verschüttet wird, wenn Behälter übertoll sind und mit hoher Geschwindigkeit gerührt werden. Die Geschwindigkeit des Magnetrührers immer langsam erhöhen und nie schneller rühren als nötig.
- ❖ NIE ein kaltes Glasgefäß auf eine Heizplatte stellen, die bereits erwärmt ist.
- ❖ NIE eine Stativstange verwenden, die länger ist als 600 mm.
- ❖ Wenn eine Stativstange mit montiertem Apparat eingebaut wird oder wenn Sie eine Stützstange drehen, achten Sie darauf, dass genügend Gewicht auf der Platte ist, damit die Gesamtkonstruktion nicht kippt.
- ❖ Wenn Sie ein Stativ verwenden, darf dessen Basis die Abmessungen von 19,5 mm Höhe und 125 mm Breite NICHT überschreiten, um eine ausreichende Belüftung des Geräts zu gewährleisten.

Bedienung

Erwärmen

UC150, UC152, US150, US152

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein (siehe Abbildung 2).



Der mit „HEAT“ gekennzeichnete Regler an der Vorderseite steuert die Wärmeabgabe und damit die Temperatur der Platte. Er verfügt über eine ungefähre Temperaturskala. Diese Skala bezieht sich auf die Temperatur der Heizplatte und nicht auf die Temperatur des Inhalts des zu erwärmenden Gefäßes.

Stellen Sie den Regler durch Drehen im Uhrzeigersinn auf die erforderliche Plattentemperatur ein. Während die Platte sich erwärmt leuchten nacheinander die LED-Temperaturabschnitte um den Regler herum. Ihre Lichtintensität erhöht sich bis die eingestellte Plattentemperatur erreicht ist. Während das Gerät abkühlt, erlöschen die LED-Temperatursegmente, wenn die Platte sich der eingestellten Temperatur nähert.

UC152D, US152D

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein (siehe Abbildung 2). Wenn der mit „HEAT“ gekennzeichnete Regler sich in der Power on/off-Position befindet, zeigt das LED-Display das Wort "OFF" (AUS). Stellen Sie den Regler auf die gewünschte Temperatur ein. Diese erscheint auf dem LED-Display. Die Temperatur kann in 5°C-Schritten erhöht werden. Wenige Sekunden nach Einstellen der Temperatur wird auf dem Display wieder die aktuelle Temperatur der Heizplatte angezeigt.

Wenn das Gerät am Netzschalter ausgeschaltet wird während der Regler auf einen bestimmten Wert eingestellt ist, zeigt das LED-Display beim nächsten Einschalten des Geräts das Wort „ON“

(AN), gefolgt von einer kurzen Einblendung der zuvor eingestellten Temperatur. Das Display wechselt dann zur Ist-Temperatur der Heizplatte und das Gerät beginnt die Platte auf die eingestellte Temperatur zu erwärmen.

 **ACHTUNG:** Wenn die Platte so heiß ist, dass sie nicht mehr berührt werden darf, beginnt die rote Warnleuchte „HOT“ an der Vorderseite zu blinken (siehe Abbildung 1). Sie blinkt maximal 30 Minuten lang, solange die Temperatur der Platte über 50°C liegt, auch wenn das Gerät von der Stromversorgung getrennt ist.

 **ACHTUNG:** Die Platte kann auch nach 30 Minuten noch heiß sein, wenn große Mengen auf der Platte stehen, obwohl die Warnleuchte „HOT“ erloschen ist.

 **ACHTUNG:** Die Oberfläche des Geräts selbst kann HEISS sein, besonders an der Luft, da Modelle mit Keramikplatte eine Oberflächentemperatur von 450°C und Modelle mit Metallplatte eine Temperatur von 325°C erreichen können. Lassen Sie die Heizplatte nicht eingeschaltet, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

Rühren

UC151, UC152, UC152D, US151, US152, US152D

Schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein (siehe Abbildung 2). Der mit „STIR“ (Rühren) gekennzeichnete Regler an der Vorderseite regelt die Geschwindigkeit des Magnetrührers. Wird er eingeschaltet, leuchtet eine grüne Kontrollleuchte (siehe Abbildung 1). Der Regler verfügt über eine willkürliche Skala von 1-9. Wird der Regler auf eine höhere Stufe eingestellt, erhöht sich die Geschwindigkeit des Magnetrührers.

Verwendung des optionalen Zubehörs: SCT1-Temperaturregler

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Der SCT1-Temperaturregler sorgt für die präzise Temperaturregelung wässriger und ölbasierter Proben im Labor und kann auf zwei verschiedene Arten verwendet werden: als präziser Temperaturregler für Temperaturen zwischen 20 und 200°C oder als digitales Thermometer zwischen -4 und 325°C.

Der Sensor des SCT1-Temperaturreglers wird über die DIN-Sensorsteckdose hinten an der Heizplatte angeschlossen (siehe Abbildung 2).

Im Regelungsmodus ist die Wärmeregulierung der Heizplatte deaktiviert, um eine präzise Regelung der Temperatur der Probe über den SCT1-Temperaturregler zu ermöglichen. Die leuchtende Kontaktthermometer-Kontrollleuchte zeigt die Kommunikation zwischen dem SCT1-Temperaturregler und der Heizplatte an (Abbildung 3).

Wenn er im Überwachungsmodus verwendet wird, fungiert der SCT1 als digitales Thermometer und die Temperatur der Heizplatte wird über den „HEAT“-Regler geregelt wie oben beschrieben. In diesem Modus beziehen sich die LED-Temperatursegmente um den „HEAT“-Regler (analoge Modelle) oder die LED-Temperaturanzeige (digitale Modelle) auf die Oberflächentemperatur der Heizplatte, nicht auf die Probe.

Weitere Hinweise zur Verwendung finden Sie in der Bedienungsanleitung zum SCT1-Temperaturregler.

Reinigung und Pflege

Vor der Reinigung:

Vergewissern Sie sich, dass die Platte abgekühlt ist, und trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung.

Zum Reinigen des Metallgehäuses ein feuchtes Tuch und einen milden Reiniger verwenden.

Geräte mit Keramikplatte:

Ein feuchtes Tuch entfernt normalerweise die meisten Verunreinigungen. Für hartnäckige Flecken wird eine haushaltsübliche Reinigungsmilch empfohlen.

Die Reinigung ist einfacher, wenn verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernt werden. In jedem Fall MÜSSEN verschüttete Laugen, Phosphorsäure und Fluorwasserstoffsäure sofort entfernt werden, da diese Chemikalien die Glaskeramik angreifen und beschädigen können. Sorgen Sie dafür, dass angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Achten Sie während der Reinigung und während des normalen Betriebs darauf, die Oberfläche der Platte nicht zu verkratzen, da dies zu thermischem Bruch führen kann.



ACHTUNG: Keramikplatten, die verkratzt, abgeblättert, chemisch angeätzt oder beschädigt sind, dürfen nicht verwendet werden.

Geräte mit Metallplatte:

Zum Reinigen der Metallplatte ein feuchtes Tuch und einen milden Reiniger verwenden.

Die Reinigung ist einfacher, wenn verschüttete Flüssigkeiten sofort entfernt werden. In jedem Fall MÜSSEN verschüttete Säuren und Laugen sofort entfernt werden, da diese Chemikalien die Oberfläche der beschichteten Aluminiumlegierung angreifen und beschädigen können. Sorgen Sie dafür, dass angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.

Vorbereitung der Medien

Besondere Vorsicht gilt für das Erwärmen von Flüssigkeiten mit einer hohen Viskosität. Viskose Flüssigkeiten können als thermische Isolatoren wirken und zu Glasbruch führen. Dies gilt besonders für Medienlösungen, da die Viskosität sich normalerweise bei steigender Temperatur erhöht.

- ❖ Überprüfen Sie, ob stark genug gerührt wird, um die gesamte Flüssigkeit in Bewegung zu versetzen. Werden Teile der Flüssigkeit nicht gerührt, kann dies zu ungleicher Wärmeübertragung und „heißen Stellen“ im Glasgefäß führen. Dies kann zu thermischer Belastung und Brüchen führen.
- ❖ Prüfen Sie den Rührvorgang regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Rührgeschwindigkeit an die steigende Viskosität der Lösung angepasst ist.
- ❖ Verwenden Sie immer den größtmöglichen Mitnehmer und wenn nötig ein mechanisches Rührwerk.
- ❖ Verwenden Sie keine dickwandigen Glasgefäße wie Pyrex Heavy Duty Ware oder herkömmliche Becher und Kolben mit einer Kapazität von 5 Litern oder mehr.

- ❖ Erwärmen Sie NIEMALS Glasflaschen auf einer Heizplatte.
- ❖ Sorgen Sie dafür, dass Flüssigkeiten sich langsam erwärmen, um lokale Überhitzung zu vermeiden.
- ❖ Achten Sie darauf, dass das Glasgefäß keinerlei Kratzer oder andere Defekte aufweist.
- ❖ Platzieren Sie die Heizplatte auf einem Tablett, das geeignet ist, um die Flüssigkeit aufzufangen, falls das Glasgefäß zerbricht.
- ❖ Tragen Sie geeignete Schutzkleidung, z.B. Handschuhe, Schutzbrille, Schutzhürze usw.

Lagerung

Das Gerät ist so konstruiert, dass der obere Teil in den unteren Teil des nächsten Geräts passt. So können mehrere Geräte auf der Seite liegend einfach und kompakt gelagert werden (siehe Abbildung 5).

Zubehör

SR1

Die Stativstange SR1 ist für Apparate gedacht, die in Verbindung mit dem Gerät verwendet werden. Das Gerät ist auf der Rückseite mit einer Halterung ausgestattet, an der die Stützstange mit der Katalognummer SR1 befestigt werden kann (siehe Abbildung 2). Um das Stativ am Gerät zu befestigen, trennen Sie das Gerät zuerst von der Stromversorgung und lassen Sie es abkühlen. Drehen Sie das Gewinde der Stativstange in die Halterung hinten am Gerät. Die Form der Basis erlaubt auch die Verwendung rechteckiger Stativständer, deren Abmessungen eine Höhe von 19,5 mm und eine Breite von 125 mm nicht überschreiten dürfen. Abmessungen des SR1: 12 x 600 mm (B x H).

SCT1

Weitere Informationen zum SCT1-Temperaturregler siehe Seite 34.

Heizblöcke

Eine komplette Palette an modularen Heizblöcken zur Erwärmung von Kolben mit runden Böden ist zur Verwendung in Kombination mit Heizplatten

mit Metallplatte erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Bibby Scientific www.bibby-scientific.com.

Fehlerbehebung

UC150, UC152, UC152D, US150, US152, US152D

Die folgenden Fehlercodes werden angezeigt, wenn das Gerät einen Fehlerzustand erkennt. Bei digitalen Modellen werden die Fehler als Er1, Er2 usw. auf dem LED-Display angezeigt. Bei analogen Modellen wird der Fehlerzustand Er1 durch Blinken der ersten LED auf der Temperaturskala, Er2 durch Blinken der zweiten LED und so weiter dargestellt.

- ❖ **Er1** – Sensorbereichfehler – Wenn der SCT1 eine Sensortemperatur von $>325^{\circ}\text{C}$ oder $<-99^{\circ}\text{C}$ anzeigt.
- ❖ **Er2** – SCT1 Kommunikationsfehler – Die Kommunikation mit dem SCT1 ist unterbrochen.
- ❖ **Er3** – Heizplattentemperaturfehler – Wenn eine Heizplattentemperatur von $>585^{\circ}\text{C}$ oder $<-9,9^{\circ}\text{C}$ gemessen wird.
- ❖ **Er4** – Heizplattenumgebungsfehler – Wenn die in der Heizplatte gemessene Temperatur (nicht die Plattentemperatur) 85°C beträgt.
- ❖ **Er5** – SCT1 Zeichenfehler – Ein unbekanntes Zeichen wurde vom SCT1 empfangen.
- ❖ **Er6** – Fehler: Sensor außerhalb – Das Gerät erkennt, dass der SCT1-Sensor aus der Lösung, die gerade erwärmt wird, entfernt wurde.
- ❖ **Er7** – SCT1 Timeout – Der SCT1 hat auf eine Anfrage nicht innerhalb der erforderlichen Zeit reagiert.

Wartung und Reparatur

Diese Produktserie erfordert keine regelmäßigen Wartungsarbeiten.

Hinweis: Die Teile im Inneren können nicht vom Benutzer gewechselt werden.

Sollte das Produkt Störungen aufweisen, empfehlen wir, Reparaturen nur von entsprechend qualifiziertem Personal durchführen zu lassen. Falls Sie Beratung oder eine Reparaturanleitung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst der Bibby Scientific Ltd.

Nur Ersatzteile von Bibby Scientific oder Händlern des Unternehmens dürfen verwendet werden. Der Einbau von nicht genehmigten Teilen kann die Funktion der Sicherheitseinrichtungen des Geräts beeinflussen.

Hinweis: Für den Magnetrührerantrieb werden starke Magnete verwendet.

Wenden Sie sich im Zweifel an den Kundendienst:

Bibby Scientific Ltd.
Stone,
Staffordshire
ST15 0SA
Vereinigtes Königreich
Tel: +44 (0)1785 810475
Fax: +44 (0)1785 813748
E-Mail: service@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Ersatzteile

Eine komplette Teileliste erhalten Sie beim Kundendienst der Bibby Scientific Ltd. gegen Angabe von Modell und Seriennummer.

Für alle anderen technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Technical Support Department:

E-Mail: stuarthelp@bibby-scientific.com,
Tel: +44 (0)1785 810433.

Garantie

Bibby Scientific garantiert, dass dieses Gerät frei von Material- und Herstellungsfehlern ist. Bei Einsatz unter normalen Laborbedingungen wird eine Garantie von **drei (3)** Jahren gewährt. Bei einem berechtigten Garantieanspruch ersetzt Bibby Scientific defekte Bauteile oder das gesamte Gerät kostenlos.

Diese Garantie gilt NICHT, wenn:

- ❖ eine Keramikplatte durch mechanische Einwirkung, Verkratzen, Abblättern oder chemische Ätzung zerbrochen ist.
- ❖ Reparaturen oder Reparaturversuche von anderen Personen als Bibby Scientific oder ihren Vertretern durchgeführt wurden.
- ❖ geringfügige Abblätterungen der Beschichtung und Kratzer in Form so genannter Gebrauchsspuren (normaler Gebrauch) auftreten.
- ❖ Schäden aufgrund von Feuer, Unfällen, Fehlgebrauch, Nachlässigkeit, falscher Einstellung oder Reparatur, Einbau, Anpassungen, Änderungen oder der Montage nicht genehmigter Teile entstehen.

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone,
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Technische Daten

Heiz- und Magnetrührer	US152	UC152	US152D	UC152D
Plattenmaterial	Beschichtetes Aluminium/Silizium	Glaskeramik	Beschichtetes Aluminium/Silizium	Glaskeramik
Plattenabmessungen, mm	150 x 150	150 x 150	150 x 150	150 x 150
Heizfläche, mm	150 x 150	120 x 120	150 x 150	120 x 120
Wärmeregulung	Analog	Analog	Digital	Digital
Wärmeleistung, W	700	500	700	500
Max. Plattentemp., °C	325	450	325	450
Min. Einstelltemp., °C	-	-	25	25
Rührgeschwindigkeit, U/min.	100-2000	100-2000	100-2000	100-2000
Max. Rührkapazität, L*	15	15	15	15
Kompatibel mit SCT1	Ja	Ja	Ja	Ja
Regelgenauigkeit mit SCT1	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Abmessungen (B x T x H), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Nettogewicht, kg	2,9	2,9	2,9	2,9
Leistung, W	750	550	750	550
Stromversorgung	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz
IP-Schutzart	32	32	32	32

Heizplatten	US150	UC150
Plattenmaterial	Beschichtetes Aluminium/Silizium	Glaskeramik
Plattenabmessungen, mm	150 x 150	150 x 150
Heizfläche, mm	150 x 150	120 x 120
Wärmeregulung	Analog	Analog
Wärmeleistung, W	700	500
Max. Plattentemp., °C	325	450
Kompatibel mit SCT1	Ja	Ja
Regelgenauigkeit mit SCT1	±1 °C	±1 °C
Abmessungen (B x T x H), mm	172 x 248 x 120	172 x 248 x 122
Nettogewicht, kg	2,2	2,2
Leistung, W	700	500
Stromversorgung	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz
IP-Schutzart	32	32

Magnetrührer	US151	UC151
Plattenmaterial	Edelstahl	Glaskeramik
Plattenabmessungen, mm	150 x 150	150 x 150
Rührgeschwindigkeit, U/min.	100-2000	100-2000
Max. Rührkapazität, L*	15	15
Kompatibel mit SCT1	Nein	Nein
Abmessungen (B x T x H), mm	172 x 248 x 109	172 x 248 x 107
Nettogewicht, kg	2,0	2,0
Leistung, W	50	50
Stromversorgung	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz	120V, 60Hz oder 230V, 50Hz oder 220V, 60Hz
IP-Schutzart	32	32

*Basierend auf Wasser enthalten in einem 20-Liter-Kolben mit Glasboden.



These products meet the relevant EC harmonised standards for radio frequency interference and may be expected not to interfere with, or be affected by, other equipment with similar qualifications. We cannot be sure that other equipment used in their vicinity will meet these standards

and we cannot guarantee that interference will not occur in practice. Where there is a possibility that injury, damage or loss might occur if equipment malfunctions due to radio frequency interference, or for general advice before use, please contact the Technical Department of Bibby Scientific Ltd.

Declaration of Conformity

UC150, UC151, UC152, UC152D US150, US151, US152, US152D, Hotplates & Stirrers

These products comply with the requirements of the EU Directives listed below:

2004/108/EC EMC Directive.
2006/95/EC Low voltage Directive (LVD)

Compliance with the requirements of these Directives is claimed by meeting the following standards:

EN 61326-1:2006 (Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory use).
EN 61010-1: 2010 (Safety Requirements Electrical Equipment for Measurement, Control and Laboratory use)
EN 61010-2-010: 2003 (Particular Requirements for Laboratory Equipment for Heating of Materials).

CE mark affixed '13.

Signed:

(Mr S. Marriott)

Date:

16/12/13

Authority: Technical Director
Bibby Scientific Ltd

Bibby Scientific

Bibby Scientific Ltd - Stone - Staffs - ST15 0SA - UK
Tel: +44 (0) 1785 812121 - Fax +44 (0) 1785 813748

INSPECTION REPORT

MODEL _____

SERIAL No. _____

ELECTRICAL SAFETY

1. Earth continuity



2. Insulation



3. Flash test



FUNCTIONAL

1. Indicators




2. Heater/stirrer control



3. Visual acceptance



QUALITY CONTROL INSPECTOR



France

Bibby Scientific Limited
Bâtiment Le Deltaparc Parc Silic PN2
7 rue du Canal
BP 55437 VILLEPINTE
95944 ROISSY Charles de Gaulle
France
Tel: +33(0)148 63 78 03
Fax: +33(0)148 63 78 01
e-mail: ventes@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

North & South America

Bibby Scientific US Inc.
t/a Techna Inc.
3 Terri Lane, Suite 10
Burlington, NJ 08016 USA
Toll Free (in NA): 800-225-9243
Tel: +1 609 589 2560
Fax: +1 609-589-2571
e-mail: labproducts@technusa.com
www.technusa.com

UK

Bibby Scientific Ltd.
Beacon Road, Stone
Staffordshire ST15 0SA
United Kingdom
Tel: +44 (0)1785 812121
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail: sales@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com

Middle East

Bibby Scientific Middle East Ltd.
PO Box 27842, Engomi 2433
Nicosia
Cyprus
Tel: +357 22 660 423
Fax: +357 22 660 424
e-mail: sales@bibby-scientificme.com

Asia

Bibby Scientific - Singapore
Prudential Tower, Level 26
30 Cecil Street
Singapore 049712
Tel: +65 6631 2976
Fax: +44 (0)1785 810405
e-mail: info@bibby-scientific.com
www.bibby-scientific.com